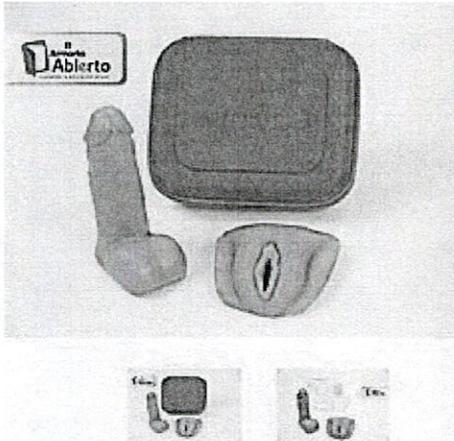
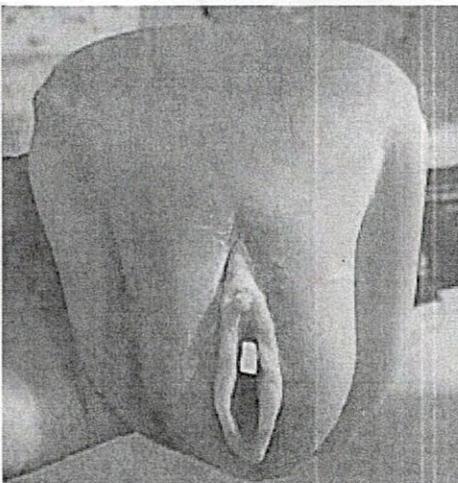


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

| | |
|-----------------------|---|
| CÉDULA DE DESCRIPCIÓN | HOJA: |
| LICITACIÓN | PROVEEDOR: |
| PARTIDA: 21701 | MARCA: |
| CANTIDAD: 23 | MODELO: |
| CLAVE S.S.: S/C | CATÁLOGO: |
| UNIDAD DE MEDIDA: KIT | ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33) |
| | CANTIDAD OFERTADA: |

NOMBRE GENÉRICO: KIT DIDÁCTICO QUE INCLUYE: MODELO PÉLVICO FEMENINO, MODELOS ANATÓMICOS DE HOMBRE Y MUJER, ROTAFOLIO INFORMATIVO Y FC2 O-CUBE.

| REGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|--------|---|----------|
| 1 | <p>KIT DIDÁCTICO</p> <p>MODELO PÉLVICO FEMENINO DE ACRÍLICO CARACTERÍSTICAS: MODELO ANATÓMICO, "CORTE ESQUEMÁTICO" DE LA ANATOMÍA FEMENINA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE</p> <p>Modelo Pélvico Acrílico</p>  <p>MODELOS ANATÓMICOS DE HOMBRE Y DE MUJER CARACTERÍSTICAS: DOS MODELOS ANATÓMICOS, ANATOMÍA MASCULINA Y FEMENINA VULVA Y PENE CON ESCROTO 13,5 CMS DE SILICONA, DE COLOR MORENO. (LAS MEDIDAS Y EL COLOR PUEDEN VARIAR)</p>   | 23 |

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

| | |
|-----------------------|---|
| CÉDULA DE DESCRIPCIÓN | HOJA: |
| LICITACIÓN | PROVEEDOR: |
| PARTIDA: 21701 | MARCA: |
| CANTIDAD: 23 | MODELO: |
| CLAVE S.S.: S/C | CATÁLOGO: |
| UNIDAD DE MEDIDA: KIT | ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33) |
| | CANTIDAD OFERTADA: |

NOMBRE GENÉRICO: KIT DIDÁCTICO QUE INCLUYE: MODELO PÉLVICO FEMENINO, MODELOS ANATÓMICOS DE HOMBRE Y MUJER, ROTAFOLIO INFORMATIVO Y FC2 O-CUBE.

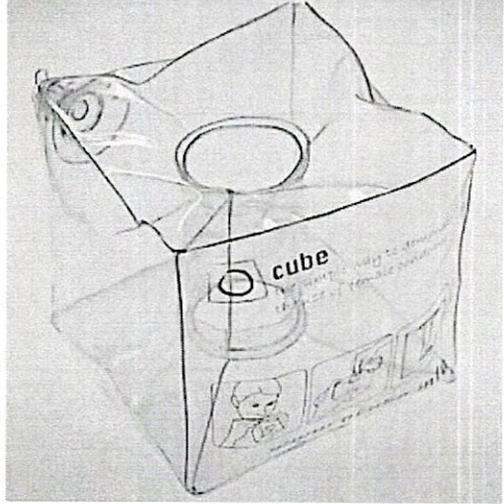
| REGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|--------|---|----------|
| | <p>ROTAFOOLIO INFORMATIVO SOBRE AUTONOMÍA REPRODUCTIVA Y ANTICONCEPCIÓN CARACTERÍSTICAS: MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO PEDAGÓGICO CONTENIDO DE TEMAS DE SALUD SEXUAL, ANTICONCEPCIÓN Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. PÁGINAS ARGOLLADAS ILUSTRADAS A TODO COLOR CON INFORMACIÓN SOBRE CADA UNO DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PUEDE CONTENER MARCADOR BORRABLE Y 2 HOJAS SOBRE LAS CUALES SE PUEDE ESCRIBIR Y BORRAR.</p>  | |


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

| | |
|-----------------------|---|
| CÉDULA DE DESCRIPCIÓN | HOJA: |
| LICITACIÓN | PROVEEDOR: |
| PARTIDA: 21701 | MARCA: |
| CANTIDAD: 23 | MODELO: |
| CLAVE S.S.: S/C | CATÁLOGO: |
| UNIDAD DE MEDIDA: KIT | ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33) |
| | CANTIDAD OFERTADA: |

NOMBRE GENÉRICO: KIT DIDÁCTICO QUE INCLUYE: MODELO PÉLVICO FEMENINO, MODELOS ANATÓMICOS DE HOMBRE Y MUJER, ROTAFOLIO INFORMATIVO Y FC2 O-CUBE.

| REGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|--------|--|----------|
| | <p>FC2 O-CUBE CARACTERÍSTICAS: ES UN MODELO DE DEMOSTRACIÓN INNOVADOR QUE HACE QUE APRENDER A USAR LOS FC2 CONDONES FEMENINOS SEA INTUITIVO Y FÁCIL. LIGERO, INFLABLE Y TRANSPARENTE, EL FC2 O-CUBE SE DESEMPACA Y SE INFLA, LISTO PARA USAR EN SEGUNDOS. DIMENSIONES DEL PAQUETE: 14CM X 17CM EL O-CUBE ESTÁ FABRICADO CON UNA LÁMINA DE PVC DE 25 MICRAS (SIN PHTHALATES 6P) Y CUMPLE LAS ESTRUCTAS NORMAS SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES PARA LOS PRODUCTOS DE JUGUETE EN LA UE. CADA O-CUBE ESTÁ EQUIPADO CON UNA VÁLVULA DE INFLADO.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>TODOS: GARANTÍA 6 MESES, SE NECESITA MUESTRA</p> | |

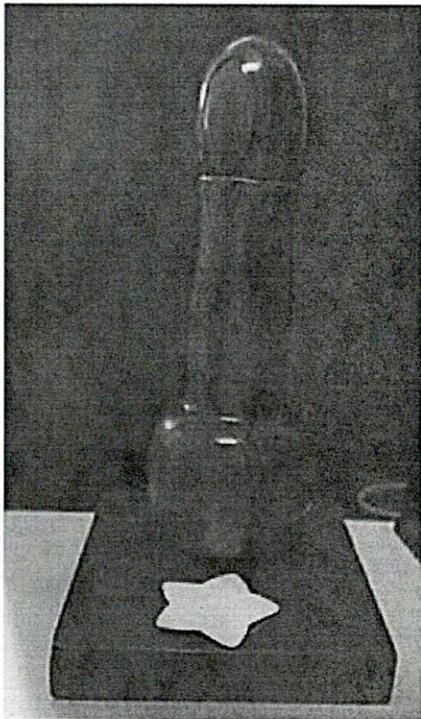
| | | |
|-----------|---|---|
| ELABORÓ: | DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES |  |
| REVISÓ: | - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | |
| AUTORIZÓ: | DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA |  |


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

| | |
|-------------------------|---|
| CÉDULA DE DESCRIPCIÓN | HOJA: |
| LICITACIÓN | PROVEEDOR: |
| PARTIDA: 21701 | MARCA: |
| CANTIDAD: 18 | MODELO: |
| CLAVE S.S.: S/C | CATÁLOGO: |
| UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA | ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21107 / FASSA (RAMO 33) |
| | CANTIDAD OFERTADA: |

NOMBRE GENÉRICO: MODELO ANATÓMICO PENE DE MADERA

| REGLÓN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|--------|--|----------|
| 2 | <p>MODELO ANATOMICO PENE DE MADERA, CON BASE. ALTO 20CM, DIAMETRO INFERIOR 25 CM, DIAMETRO SUPERIOR 15 CM. BASE CUADRADA: ESPESOR DE LA BASE 2CM , LADO 13CM. GARANTÍA DE 6 MESES</p>  | 18 |

| | | |
|-----------|---|---|
| ELABORÓ: | DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES |  |
| REVISÓ: | - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES | |
| AUTORIZÓ: | DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA |  |