



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 31	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21223, 20801, 20807, 20602, 20308 FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: AUDÍFONOS DIADEMA CON MICRÓFONO USB PARA PC

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>DIMENSIONES: ALTURA 171mm, ANCHO: 151 mm, PROFUNDIDAD 68mm Y PESO: 0.197kg</p> <p>BANDA CON ALMOHADILLAS PARA LA CABEZA Y ALMOHADILLAS PARA LAS OREJAS</p> <p>TIPO DE MICROFONO: BIDIRECCIONAL, ROTATIVO CON CANCELACION DE RUIDO</p> <p>CONTROLES CONVENIENTES EN LINEA PARA EL VOLUMEN Y SILENCIADOR</p> <p>CONEXIÓN INALAMBRIA POR USB-A CON TECNOLOGIA PLUG Y PLAY PARA USARLOS SIN NECESIDAD DE CONECTARLOS</p> <p>COMPATIBLES CON LOS SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS, MACROS O CHROME OS</p> <p>PUERTOS USB O ADAPTADOR TIPO A LONGITUD DE CABLE 1.9 M</p> <p>12 MESES DE GARANTÍA</p> 	31

ELABORÓ:	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 29401	MARCA:	
CANTIDAD: 10	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21223, 20308 FASSA (RAMO 33)	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: BOCINA PARA PC, BLUETOOTH, INALÁMBRICO, 2.0, 5 WATTS, COLOR NEGRO.		
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	ESPECIFICACIONES CANTIDAD DE PARLANTES: 1 FORMATO DEL PARLANTE: CILÍNDRICO CON MODO MANOS LIBRES: NO ES PORTÁTIL: SÍ ES INALÁMBRICO: SÍ CONECTIVIDAD: BLUETOOTH PESO Y DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA 18.1 CM X 6.9 CM X 7.4 CM PESO 540 G SONIDO POTENCIA DE SALIDA (RMS): 20 W TIPOS DE FILTROS DEL PARLANTE: ACTIVO RESPUESTA MÍNIMA EN FRECUENCIA - RESPUESTA MÁXIMA EN FRECUENCIA BATERÍA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA: 12 H INCLUYE BATERÍA RECARGABLE: SÍ INCLUYE CARGADOR: SÍ OTROS ES A PRUEBA DE AGUA: SÍ ES APTO PARA USO EN EXTERIORES: SÍ CONECTIVIDAD CON BLUETOOTH: SÍ CONECTORES DE ENTRADA: USB-C OTROS COLOR PRINCIPAL: NEGRO	10



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21223, 20308 FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BOCINA PARA PC, BLUETOOTH, INALÁMBRICO, 2.0, 5 WATTS, COLOR NEGRO.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	TIPOS DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA, USB GARANTÍA: 12 MESES 	

ELABORÓ:	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 24	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21223, 20801, 20602, 20401, 20308 FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CÁMARA PARA VIDEOCONFERENCIAS, FULL HD 1080p, CONEXIÓN ALÁMBRICA USB.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CÁMARA WEB DE ALTA DEFINICIÓN FULL HD 1080P. • VELOCIDAD DE FOTO: 25FPS / 30FPS • PÍXELES: 2.0 MEGA PÍXELES. • MICRÓFONO INTEGRADO • INTERFAZ: USB V2.0 • PÍXELES EFECTIVOS: 1932 (H) × 1088 (V) • RESOLUCIÓN HORIZONTAL: 200 W. • RELACIÓN SEÑAL A RUIDO: > 50 DB. • UV: 640 X 360. • OBTURADOR ELECTRÓNICO: AUTOMÁTICO. • ACUERDO: UVC / UVA. • SALIDA DE VÍDEO: TRANSMISIÓN DE VÍDEO USB • VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: CC 5 V, 160 MA ± 6 MA. • FLUJO DE VÍDEO: H.264: 1920 X 1080/1920 X 720/640 X 360 MJPEG: 1920 X1080/1920 X 720/640 X 360. • COMPRESIÓN AUTOMÁTICA DEL COLOR. • ROTACIÓN DE 120 GRADOS. • COMPATIBLE CON VISTA / WIN7 / WIN8 / WIN10, ANDROID, LINUX Y MAC OS. • INCLUYA CD-ROM CON SOFTWARE, CONTROLADORES Y DOCUMENTACIÓN. • EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO, EN EL MISMO PORTAL SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS. 	24




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 24	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21223, 20801, 20602, 20401, 20308 FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CÁMARA PARA VIDEOCONFERENCIAS, FULL HD 1080p, CONEXIÓN ALÁMBRICA USB.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CONTANDO CON UN CALL CENTER PARA TODOS LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL O UN 01 800. 	
		

ELABORÓ: <i>gr</i>	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

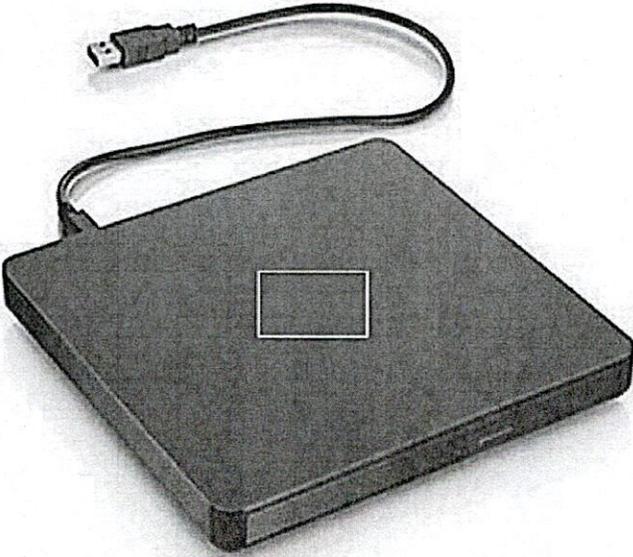



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20602, 20201 FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LECTOR/QUEMADOR DE CD/DVD EXTERNA, USB 2.0, COLOR NEGRO.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>INTERFAZ: USB 2.0 QUEMADOR DE DVD, DVD±RW 8x PESO Y DIMENSIONES: AL. 144 MM, PR. 14 MM, AN. 137 MM. CONTENIDO DEL EMBALAJE: CYBERLINK MEDIA SUITE CONSUMO ENERGÉTICO 8W 1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DEL FABRICANTE</p> 	2

ELABORÓ: 	DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD /DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 14	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20801, 20807, 20602, 20308 FASSA (RAMO 33) CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MOUSE CONEXIÓN INALÁMBRICA CON NANO RECEPTOR USB. RESOLUCIÓN DE 1000 DPI Y PLUG & PLAY. ERGONÓMICO COMPATIBLE CON WINDOWS Y MAC.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<p>MOUSE INALÁMBRICO/ NANO RECEPTOR DE 2.4 GHZ / BLUETOOTH/ PC / LAPTOP / MAC.</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.</p> <ul style="list-style-type: none"> •SENSOR ÓPTICO •HASTA 1000 DPI •RECEPTOR NANO USB DE 2.4 GHZ •TECNOLOGÍA BLUETOOTH •DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 10 METROS •DISEÑO EXTRA COMPACTO •HASTA 90% MENOS RUIDOSO •2 BOTONES •1 RUEDA DE DESPLAZAMIENTO •CONFIGURACIÓN PLUG & PLAY •DISEÑO ERGONÓMICO •ALTA EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA •REQUIERE 1 BATERÍA "AA", PREINSTALADA (HASTA 18 MESES DE USO CONTINUO) •COMPATIBILIDAD: WINDOWS, MAC, CHROME OS, LINUX, IPADOS •REQUIERE PUERTO USB DISPONIBLE O TECNOLOGÍA BLUETOOTH •EL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, DEBE CONTAR CON UNA PÁGINA WEB, QUE TENGA POR DOMINIO EL NOMBRE DE LA MARCA DE DICHO EQUIPO. EN DICHA PÁGINA SE DEBERÁN CONSULTAR Y BAJAR LOS CONTROLADORES Y PARCHES SIN COSTO PARA LA CONVOCANTE REFERENTES AL MODELO DEL EQUIPO Y CON COMPATIBILIDAD PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS. 	14

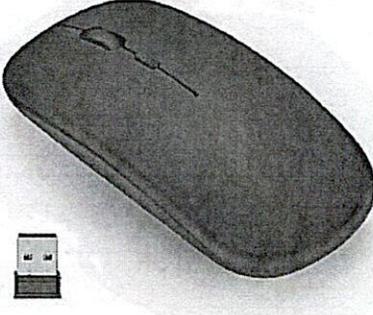



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 14	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20801, 20807, 20602, 20308 FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MOUSE CONEXIÓN INALÁMBRICA CON NANO RECEPTOR USB. RESOLUCIÓN DE 1000 DPI Y PLUG & PLAY. ERGONÓMICO COMPATIBLE CON WINDOWS Y MAC.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>*1 AÑO DE GARANTÍA EN SITIO, EN PARTES Y MANO DE OBRA, OTORGADA Y AVALADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, CONTANDO CON UN CALL CENTER PARA TODOS LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE UN NUMERO LOCAL O UN 01 800.</p> 	

ELABORÓ: 	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

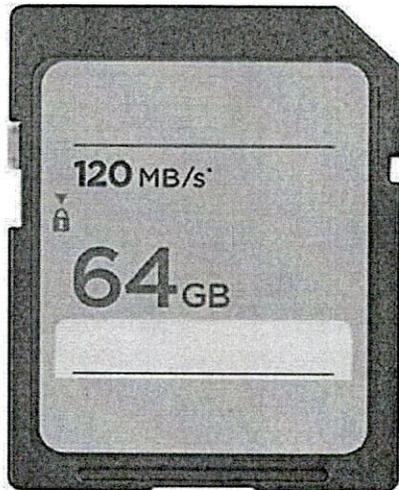


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 29401	MARCA:
CANTIDAD: 7	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20602 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TARJETA DE MEMORIA SD CLASE 10 DE 64 GB PARA CAMARA CANON REBEL T6.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>TIPO DE MEMORIA SDXC COLOR NEGRO INTERFAZ DE HARDWARE: MICROSDXC CLASE DE VELOCIDAD: CLASE 10 CAPACIDAD 64 GB. RESOLUCIÓN MÁXIMA DE VÍDEO: 4K. VELOCIDAD DE LECTURA: 150 MB/S. 1 AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DEL FABRICANTE</p> 	7

ELABORÓ:	ING. ELVIRA XOCHIQUISQUI ATLAHUA - DEPARTAMENTO DE SALUD DEL MIGRANTE Y PUEBLOS INDÍGENAS 
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 