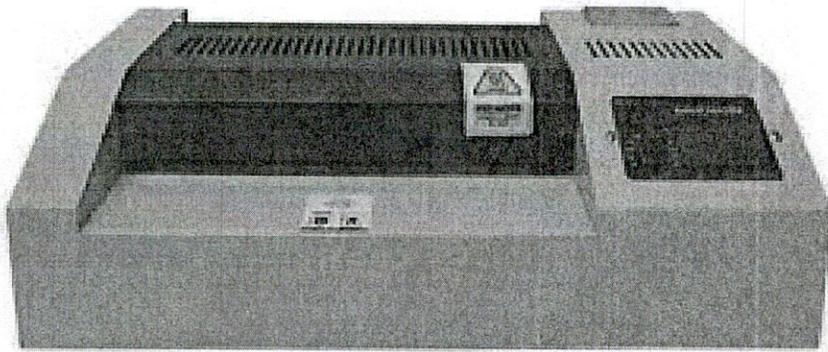


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN TEMPORAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20201 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ENMICADORA TERMICA, ANCHO DE ENTRADA 12", VELOCIDAD 13" POR MINUTO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>ENMICADORA DE USO RUDO, TRABAJA CON MICAS TÉRMICAS DE 3, 5, 8, Y 10 MILESIMAS CON UN ACABADO PERFECTO, CONTROL DE TEMPERATURA, INDICADOR DE TEMPERATURA HASTA 180 GRADOS, EN MICA EN CALIENTE PARA MICA TÉRMICA Y EN FRÍO PARA MICA ADHERIBLE, AVANCE Y RETROCESO, 4 RODILLOS DE CALOR.</p> <p>ANCHO DE ENTRADA 12", VELOCIDAD 13" POR MINUTO</p> <p>24 MESES DE GARANTÍA CON EL FABRICANTE</p> 	1

ELABORÓ:	C.P. LAURA IVETH BARRIENTOS ACEVEDO - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 
REVISÓ:	C.P. MARTHA ELIZABETH BALTAZARES LIPP - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21315 SUBSIDIO ESTATAL / 21304 20201 FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

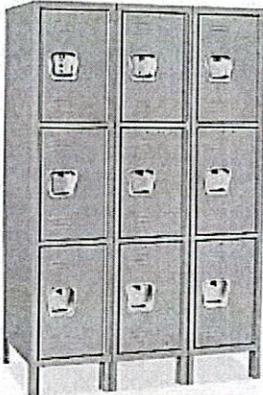
NOMBRE GENÉRICO: GUILLOTINA MANUAL CORTADORA DE PAPEL DE 12 PULGADAS (31 CM).

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>1 GUILLOTINA MANUAL 2 DE 12 PULGADAS O 31 CM 3 HOJA DE ACERO INOXIDABLE 4 CON CUADRICULA DE ALINEACIÓN 5 CON REGLA DE DOBLE ESCALA 6 CON BARANDILLA PROTECTORA 7 CON GANCHO DE CIERRE PARA BLOQUEAR LA CUCHILLA 8 PATAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES 9 GARANTÍA DE 24 MESES 10 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR DIRECTAMENTE EN ESTOS SESVER</p> 	3

ELABORÓ:	<p>9 SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES</p> 
REVISÓ:	<p>DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES</p> 
AUTORIZÓ:	<p>DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA</p> 

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 51901	MARCA:	
CANTIDAD: 4	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21307 / FASSA (RAMO 33)	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: LOCKERS DE ALTA CALIDAD TRES PUERTAS DE ALTO, 3 DE ANCHO, ENSAMBLADOS, ANCHO 36", PROFUNDIDAD DE 18"		
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>LOCKERS DE ALTA CALIDAD - TRES PUERTAS DE ALTO, 3 DE ANCHO, ENSAMBLADOS, ANCHO DE 36", PROFUNDIDAD DE 18" PUERTAS SUPERSILENCIOSAS Y REFORZADAS. FABRICADOS EN ACERO CALIBRE PESADO. LAS REJILLAS PERMITEN QUE CIRCULE EL AIRE. PATAS INCLUIDAS - AGREGAN 6" A LA ALTURA. ASAS EMPOTRADAS DE ACERO INOXIDABLE OFRECEN SEGURIDAD ADICIONAL. GANCHOS PARA CHAMARRAS INCLUIDOS. USE CONCANDADOS DE COMBINACIÓN INTEGRADOS PARA LOCKER. GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	4

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	

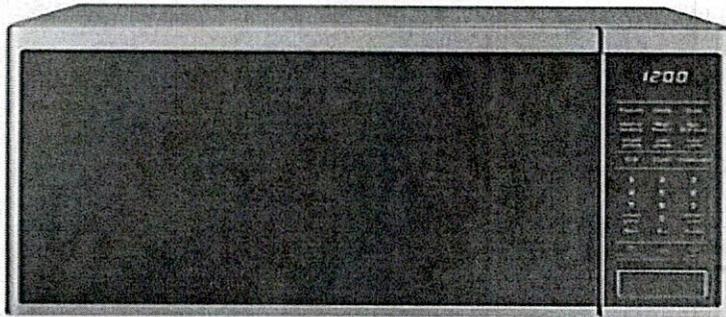
**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21304 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICROONDAS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	1 HORNO DE MICROONDAS 2 COLOR ACERO 3 CON PLATO GIRATORIO 4 CON TEMPORIZADOR PROGRAMABLE 5 CON DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA 6 CON PANEL DE CONTROL DIGITAL 7 CON LUZ INTERIOR 8 PLATO DE 36 CM DE DIAMETRO 9 POTENCIA DE 1600 W 10 VOLTAJE 127 VOLTS 11 GARANTÍA DE 24 MESES 12 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR DIRECTAMENTE EN LOS ALMACENES DE ESTOS SESVER	3

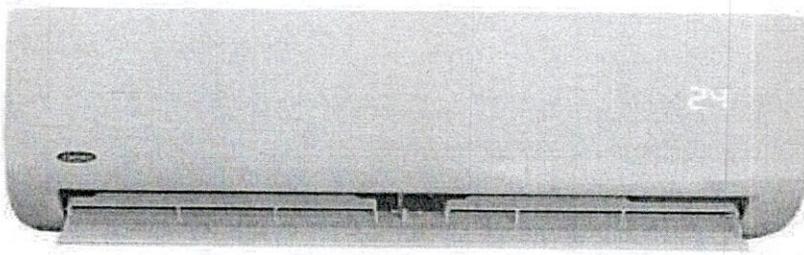


ELABORÓ:	MTRA. CYNTHIA ALARCÓN MORA - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES <i>Cynthia Alarcón Mora</i>
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA <i>Guadalupe Díaz del Castillo Flores</i>



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 51901	MARCA:	
CANTIDAD: 21	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21315 SUBSIDIO ESTATAL / PROCESO 21307 21304 21101 21307 20308 FASSA (RAMO 33)	
CANTIDAD OFERTADA:		
NOMBRE GENÉRICO: MINISPLIT 12000 BTU		
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	1 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 12,000 BTU 3 CORRIENTE 220V 4 RANGO DE TEMPERATURA EN FRIO 17-32 °C 5 RANGO DE TEMPERATURA EN CALOR 0-30 °C 6 CON FILTRO DE CARBÓN INCORPORADO 7 ÁREA DE COBERTURA 0-12 M2 8 CON 6 VELOCIDADES 9 FILTRO DE ALTA DENSIDAD 10 CON CONTROL REMOTO 11 CON TEMPORIZADOR 12 COLOR BLANCO 13 MATERIAL PLÁSTICO Y METAL 14 GARANTÍA DE 24 MESES 15 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ALMACÉN DE ESTOS SESVER.	21
		

ELABORÓ:	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 67	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20807 21307 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMO DE 45 LITROS

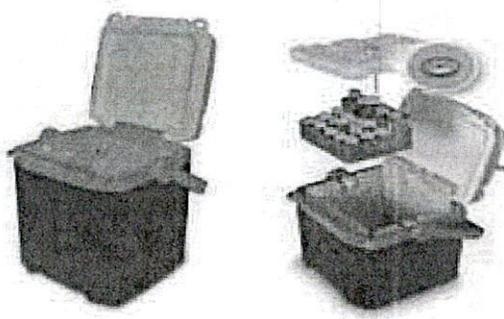
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, PAREDES LISAS, SOLIDAS, LAVABLES, INERTES, NO CORROSIVAS Y NO REACTIVAS.</p> <p>CAPACIDAD DE 45 LITROS, CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA POR DEBAJO DE 8°C HASTA POR 36 HORAS AUNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C</p> <p>EN COLOR CLARO Y LAVABLE, CON ROSCA DE USO RUDO HERMÉTICA Y CONTRATAPA PARA MINIMIZAR FUGAS. CON TAPA TIPO COFRE CON SELLADO HERMÉTICO Y BISAGRAS</p> <p>CON CURVAS SANITARIAS AL INTERIOR. AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 2 CMS ALTA DENSIDAD (38 A 40 KG/M3) LIBRE DE CFC.</p> <p>DEBE INCLUIR 1 JUEGO DE 20 PAQUETES REFRIGERANTES (VACIOS, SIN GEL U OTRA SUSTANCIA) RESISTENTES Y REUTILIZABLES.</p> <p>ISO 9001:2015</p> <p>GARANTIA DE 24 MESES</p> <p>SE REQUIERE MUESTRA</p>	67



ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	<i>[Signature]</i>
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	<i>[Signature]</i>

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

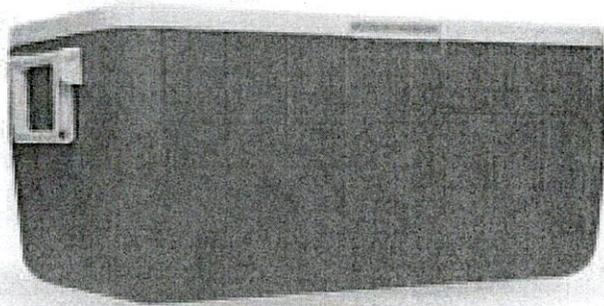
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 51901	MARCA:	
CANTIDAD: 555	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21315 SUBSIDIO ESTATAL/PROCESO 21110 20807 21307 FASSA (RAMO 33) CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: TERMO DE 9 LITROS		
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<p>ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, PAREDES LISAS, SOLIDAS, LAVABLES, INERTES, NO CORROSIVAS Y NO REACTIVAS. CAPACIDAD DE 9 LITROS, CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA POR DEBAJO DE 8°C HASTA POR 36 HORAS AUNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C EN COLOR CLARO Y LAVABLE, CON ROSCA DE USO RUDO HERMÉTICA Y CONTRATAPA PARA MINIMIZAR FUGAS. CON TAPA TIPO COFRE CON SELLADO HERMÉTICO Y BISAGRAS CON CURVAS SANITARIAS AL INTERIOR.</p> <p>AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 2 CMS ALTA DENSIDAD (38 A 40 KG/M3) LIBRE DE CFC.</p> <p>DEBE INCLUIR 1 JUEGO DE 6 PAQUETES REFRIGERANTES (VACIOS, SIN GEL U OTRA SUSTANCIA) RESISTENTES, REUTILIZABLES PARA ARMAR UN CUBO AL INTERIOR DEL TERMO, QUE DEBERA CUBRIR TODAS LAS PAREDES (6 PIEZAS: 4 PAREDES, 1 BASE Y 1 TAPA),LA TAPA DEBERÁ CONTAR CON UNA PERFORACIÓN AL CENTRO PARA LA COLOCACIÓN DEL TERMÓMETRO DE VÁSTAGO. UNA CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE CON SEPARACIÓN A LA MITAD Y PERFORADA.</p> <p>ASA RESISTENTE PARA SOPORTAR HASTA 30 KGS.</p> <p>ISO 9001:2015</p> <p>GARANTIA DE 24 MESES.</p> <p>SE REQUIER MUETRA.</p>	555
		
ELABORÓ:	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	


**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 51901	MARCA:
CANTIDAD: 34	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20807 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMO DE 90 LITROS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	<p>ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, PAREDES LISAS, SOLIDAS, LAVABLES, INERTES, NO CORROSIVAS Y NO REACTIVAS</p> <p>CAPACIDAD DE 90 A 100 LITROS, CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA POR DEBAJO DE 8°C HASTA POR 36 HORAS AUNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C.</p> <p>EN COLOR CLARO Y LAVABLE, CON ROSCA DE USO RUDO HERMÉTICA Y CONTRATAPA PARA MINIMIZAR FUGAS. CON TAPA TIPO COFRE CON SELLADO HERMÉTICO Y BISAGRAS.</p> <p>CON CURVAS SANITARIAS AL INTERIOR. AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 2 CMS ALTA DENSIDAD (38 A 40 KG/M3) LIBRE DE CFC</p> <p>DEBE INCLUIR 1 JUEGO DE 40 PAQUETES REFRIGERANTES (VACIOS, SIN GEL U OTRA SUSTANCIA) RESISTENTES Y REUTILIZABLES.</p> <p>ISO 9001:2015</p> <p>GARANTIA DE 24 MESES</p> <p>SE REQUIERE MUESTRA</p> <div align="center">  </div>	34

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	