



**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 6	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21305 21104 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BAFLE AMPLIFIC PASIVO 15 2 MIC INALAMBRICOS. BLUETOOTH AW MSI 31.75 kg

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	1 BOCINA BAFFLE 2 2 VÍAS CON AMPLIFICADOR 3 WOOFER 15 PULGADAS CON 50 MM DE VC 4 TWEETER 25 MM 5 FRECUENCIA DE CORTE 2.5 KHZ 6 SENSIBILIDAD DE 96 dB 7 RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 HZ-20K HZ (10 dB) 8 POTENCIA MÁXIMA DE 15,000 W 9 IMPEDANCIA NOMINAL DE 8 Ohm 10 CONECTOR Y ENTRADA DE TIPO SPEAKON 11 2 ENTRADAS PARA MICRÓFONOS 12 CON USB, MP3, SD, RADIO FM, BLUETOOTH 13 CON CONTROL REMOTO 14 QUE INCLUYA 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 15 QUE INCLUYA PEDESTAL 16 GARANTÍA 24 MESES 17 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL ALMACÉN DE ESTOS SESVER.	6



ELABORÓ:	MTRA. CYNTHIA ALARCÓN MORA - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES <i>Cynthia Alarcón Mora</i>
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA <i>Guadalupe Díaz del Castillo Flores</i>



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 9	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21305 20807 21601 20308 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BOCINAS INALÁMBRICAS BLUETOOTH BATERÍA INTEGRADA RECARGABLE DE IONES DE LITIO RESISTENCIA AL AGUA CONFORME A LA NORMA IPX7 .

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>TOTAL DE VATIOS REALES (RMS): 5 W BLUETOOTH: 4.1 CONFIABLE RADIO DE ACCIÓN DE 20 METROS CON LÍNEA DE VISIÓN DIRECTA ENTRADA DE 3,5 MM: 1 TOMA DE AURICULARES: 1 EMPAJEAMIENTO BLUETOOTH Y CONTROLES DE VOLUMEN SITUADOS EN LA PARTE FRONTAL DEL ALTAVOZ DERECHO. COLOR NEGRO ALTURA X ANCHURA X PROFUNDIDAD: 241 MM X 90 MM X 124 MM. GARANTIA 24 MESES</p> 	9

ELABORÓ:	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 21	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20305 SUBSIDIO ESTATAL/ 21104 20807 21601 FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

**NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO VIDEO PROYECTOR POWERLITE X39, XGA 3500 LÚMENES BLANCO Y COLOR. 3LCD CON X 2 HDMI PARA CORPORATIVO WI-FI OPCIONAL**

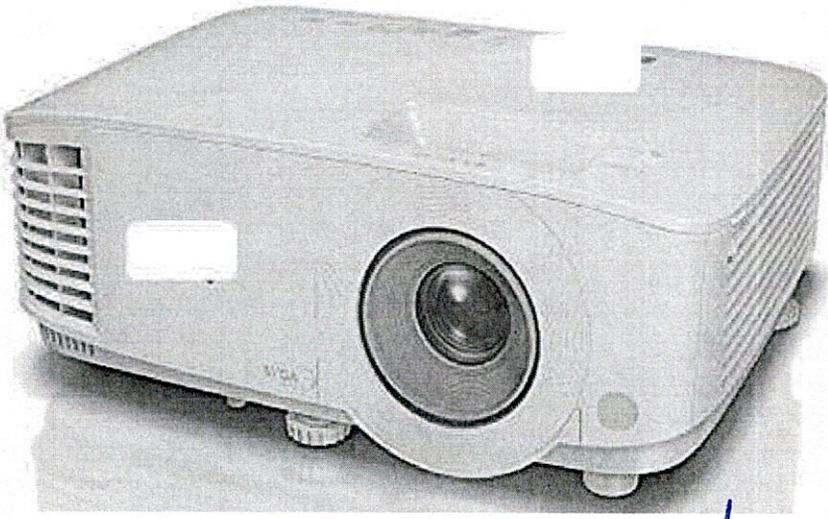
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<b>ESPECIFICACIONES GENERALES</b> 1 SISTEMA DE PROYECCIÓN: SISTEMA DE PROYECCIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO RGB 2 MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / RETROPROYECCIÓN / COLGADO DEL TECHO 3 NÚMERO DE PÍXELES: 786,432 PUNTOS (1024 X 768) X 3 4 LUMINOSIDAD DE COLOR: BRILLO EN COLOR: 2.700 LÚMENES 5 LUMINOSIDAD DEL BLANCO: BRILLO EN BLANCO: 2.700 LÚMENES 6 RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3 7 RESOLUCIÓN NATIVA: XGA 8 TIPO DE LÁMPARA: 200 W UHE 9 VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: HASTA 10.000 HORAS (MODO ECO); HASTA 5.000 HORAS (MODO NORMAL) 10 DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 30" A 300" [0.89 A 9.12 M] (ZOOM: WIDE); 30" A 300" [1.07 A 10.95 M] (ZOOM: TELE) 11 CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL + 30 GRADOS; HORIZONTAL + 30 GRADOS 12 USB 3 EN 1: TRANSMITE IMAGEN, AUDIO Y CONTROL DE PRESENTACIÓN DE POWER POINT 13 RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 10000:1 14 REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1.07 BILLÓN DE COLORES LENTE DE PROYECCIÓN 15 TIPO: FOCO MANUAL 16 NÚMERO F: 1.58-1.72 17 DISTANCIA FOCAL: 16,9MM - 20,28MM 18 THROW RATIO: RANGO 1.48 - 1.77 19 RELACIÓN DE ZOOM: 1-1.2 (ÓPTICO) CONECTIVIDAD 20 RJ-45 x 1; 21 MÓDULO INALÁMBRICO 802.111 B/G/N (OPCIONAL), VGA X 2, HDMI X 1, VIDEO COMPUESTO X 1, S-VIDEO X 1, AUDIO IN, RS-232C X 1, VIDEO OUT X 1, USB A/B X 1 OTROS 22 PARLANTE: 5W MONO 23 CONSUMO DE ENERGÍA 110V A 120V: 284W (NORMAL) 208 (ECO) 24 CONSUMO DE ENERGÍA 220V A 240V: 273W (NORMAL) 204 (ECO) 25 DIMENSIONES (ANCHO X PROF. X ALT.): 297 X 87 X 244 MM 26 PESO: APROX. 5.8 LBS. / 2.6KG ACCESORIOS	21

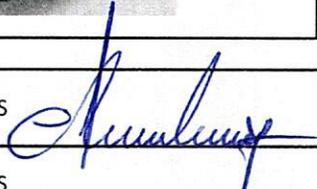

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 21	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 20305 SUBSIDIO ESTATAL/ 21104 20807 21601 FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO VIDEO PROYECTOR POWERLITE X39, XGA 3500 LÚMENES BLANCO Y COLOR. 3LCD CON X 2 HDMI PARA CORPORATIVO WI-FI OPCIONAL

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	27 LÁMPARA DE REEMPLAZO 28 FILTRO DE AIRE DE REEMPLAZO 29 MÓDULO LAN INALÁMBRICO GARANTÍA 30 2 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS MISMOS. NORMAS 31 NOM-001-SCFI-1993, NOM-024-SCFI-2013, NOM-008-SCFI-2002.	
		

ELABORÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	

**AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

**FICHA TÉCNICA**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21305 20807 21601 20308 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICRÓFONO CONDENSADOR MODELO C3 16 BIT.  
MONTABLE. DE DIAFRAGMA DUAL. PATRONES POLARES: UNIDIRECCIONAL. RESPUESTA DE FRECUENCIA: 20 HZ - 16 KHZ.  
CONECTOR DE SALIDA XLR

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	1 MICRÓFONO CONDENSADOR 2 MODELO C3 16 BIT 3 MONTABLE 4 DE DIAFRAGMA DUAL 5 PATRONES POLARES: UNIDIRECCIONAL. 6 RESPUESTA DE FRECUENCIA: 20 HZ - 16 KHZ. 7 CONECTOR DE SALIDA XLR 8 GARANTÍA DE 24 MESES	4



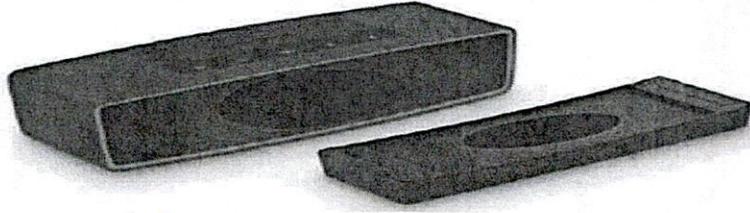
ELABORÓ:	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPÍN RAMÍREZ - SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD/ - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

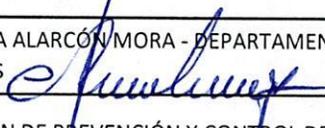
AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA:
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO 21305 / FASSA (RAMO 33)
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SISTEMA PORTÁTIL DE AUDIO DE 1,000 W PMPO CON LECTOR DE MEMORIA SD, RECARGABLE

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<p>1 SISTEMA PORTÁTIL DE AUDIO ALTAVOZ</p> <p>DIMENSIONES</p> <p>2 ALTAVOZ CON 5.1 CM DE ALTO X 18 CM DE ANCHO X 5.8 CM DE PROFUNDIDAD (0.68 KG)</p> <p>3 BASE DE CARGA DE 1.6 CM DE ALTO X 15.7 CM DE ANCHO X 5.1 CM DE PROFUNDIDAD (79 G)</p> <p>4 CARGADOR DE PARED: 6.7 CM DE ALTO X 4.8 CM DE ANCHO X 1.5 CM DE PROFUNDIDAD</p> <p>5 CABLE DE 9.44 CM DE LARGO</p> <p>6 ENTRADAS/SALIDAS</p> <p>7 AUXILIAR DE 3.5 MM</p> <p>8 PUERTO USB MICRO-B</p> <p>DETALLES</p> <p>9 ALCANCE INALÁMBRICO DE HASTA 9 M (30 PIES)</p> <p>10 DURACIÓN DE LA BATERÍA DE HASTA 10 HORAS</p> <p>11 POTENCIA NOMINAL: 100-240 V</p> <p>12 GARANTÍA DE 24 MESES</p> <p>13 EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR DIRECTAMENTE EN LOS ALMACENES DE ESTOS SESVER</p> 	4

ELABORÓ:	MTRA. CYNTHIA ALARCÓN MORA - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 
REVISÓ:	- SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 