



**ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LAS ÁREAS DE GINECO-OBSTETRICIA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2022.**

EN LA CIUDAD DE XALAPA – ENRÍQUEZ, VERACRUZ, SIENDO LAS **DIEZ HORAS DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 Y 6.4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITA EN SOCONUSCO N° 31, COLONIA AGUACATAL, C.P. 91130, XALAPA, VER., LOS C.C. **LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA**, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; **C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, **L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; **LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA**, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA; **L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ** Y **LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO**, COTIZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN, ASIMISMO, SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE LOS C.C. **MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS** Y **MTRO. GUILLERMO RAMÓN HERNÁNDEZ**, REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, DESIGNADOS MEDIANTE OFICIO No. **OIC/SS-SESVER/FI/3658/2022**, ASIMISMO LAS EMPRESAS PARTICIPANTES: **DICIPA S.A. DE C.V.**, **CONDUIT LIFE S.A. DE C.V.**, **GRUPO MOBS S.A. DE C.V.** Y REPRESENTADAS POR LOS C.C. MIGUEL ÁNGEL BRIONES HERNÁNDEZ, DANIEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ Y JOSÉ MARÍA TAGANO RUIZ, RESPECTIVAMENTE A EFECTO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LPN-103T00000-026-2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LAS ÁREAS DE GINECO-OBSTETRICIA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS, PERTENECIENTES A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON RECURSO FISE 2022.

EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRÓ BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

- 1.- PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.-----
- 2.- PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITANTES. -----
- 3.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN. -----
- 4.- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----
- 5.- CIERRE DEL ACTA Y FIRMA DE LA MISMA, POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO. -----



-----HECHOS-----

1.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN -----

**POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

NOMBRE	CARGO
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA
LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ	COTIZADORAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO	

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

NOMBRE	CARGO
MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ.
MTRO. GUILLERMO RAMÓN HERNÁNDEZ	

2.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A LA PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. -----

**POR LOS LICITANTES**

EMPRESA	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DICIPA, S.A. DE C.V.	C. MIGUEL ÁNGEL BRIONES HERNÁNDEZ
CONDUIT LIFE S.A. DE C.V.,	C. DANIEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ
GRUPO MOBS S.A. DE C.V.	C. JOSÉ MARÍA TAGANO RUIZ

QUIENES ACREDITAN SU PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SU PARTICIPACIÓN DE ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 6.2 DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN-----

3.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE NO SE TIENEN MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES A LAS BASES DE PARTICIPACIÓN. -----

4.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDIÓ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE ACUERDO AL OFICIO **SESVER/DAM/SAH/DATH/18658/2022**, DE FECHA **29 DE**



NOVIEMBRE DEL 2022, SIGNADO POR LA DOCTORA ROMANA GUTIÉRREZ POLO, DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA.

1.-PROVEEDOR: PROVEEDOR HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.

A). -DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

No	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	PUNTO 7.1.3 DEBEMOS ENTENDER QUE EL FOLIADO ES SOLAMENTE PARA CONTROL DE DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE EL NO FOLIAR LAS PROPUESTAS NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	PUNTO 7.1.4. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO DEBERÁN LLEVAR FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL, LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL LICITANTE, (CARTAS, FORMATOS/ANEXOS, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA), MÁS NO LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR TERCEROS (DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD, CATÁLOGOS, MANUALES, ETC.) ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.  EN EL PUNTO 10 DE LAS BASES SE INDICA LO SIGUIENTE:  PUNTO 10: DE LA DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.  10.1. SE DESCALIFICARÁ A LOS PARTICIPANTES QUE INCURRAN EN ALGUNO(S) DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:  1. <u>NO FIRMEN DE MANERA AUTÓGRAFA TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS</u> , RESPECTIVAMENTE, INCLUYENDO LOS SOBRES QUE LAS CONTENGAN;
3	PUNTO 7.2.12. PREGUNTA: DEBEMOS ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PARA BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL BASTARA CON PRESENTAR FDA, O CE, O CERTIFICADO DE LIBRE VENTA E ISO 13485 O ISO 9001, SEGÚN CORRESPONDA AL PAIS DE ORIGEN ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	PUNTO 7.2.12  DEBEMOS ENTENDER QUE ADICIONAL A LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD DE LOS EQUIPOS, SE DEBERÁ PRESENTAR EL ISO 9001, QUE ES LA NORMA QUE CERTIFICA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE PROPORCIONA LA INFRAESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS, PROCESOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA AYUDAR A LAS ORGANIZACIONES A CONTROLAR Y MEJORAR SU RENDIMIENTO Y CONDUCIRLES HACIA LA EFICIENCIA, SERVICIO AL CLIENTE Y EXCELENCIA EN EL PRODUCTO A NOMBRE DEL LICITANTE ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



5	<p>PUNTO 7.2.12</p> <p>DEMOS ENTENDER QUE LA NOM-010-SCFI-1994, NO APLICA PARA LAS PARTIDAS 2 Y 10, YA QUE SE REFIERE A INSTRUMENTOS DE MEDICION. ¿ES CORRECTO?</p> <p>PUNTO 7.2.12</p> <p>DEMOS ENTENDER QUE EN LUGAR DE LA NOM-010-SCFI-1994, (INSTRUMENTOS DE MEDICION), PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE EL ALTA QUE EXPIDE LA COFEPRIS DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA A NOMBRE DEL LICITANTE CORRESPONDIENTE A LA NOM-240-SSA1-2012, QUE ES LA NORMA ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS SOBRE LOS CUALES SE DEBEN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA TECNOVIGILANCIA CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL PACIENTE Y LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS. ESTUDIOS CON LOS MISMOS PARA LOS USUARIOS DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS ¿ES CORRECTO?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA QUE PODRÁ PRESENTAR COPIA DE EL ALTA QUE EXPIDE COFEPRIS DE LA UNIDAD DE TECNOVIGILANCIA A NOMBRE DEL RESPONSABLE DE SUS PRODUCTOS EN MÉXICO.</p>
6	<p>PUNTO 7.2.27.</p> <p>En relación al acuerdo del 22 de septiembre de 2022 del Diario Oficial:</p> <p>“ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único.</p> <p>Cláusula Novena.- Vigencia. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada.”</p> <p>POR TAL MOTIVO, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHA OPINION CON FECHA DE UNO O DOS DIAS DE ANTICIPACION A LA PRESENTACION.DE PROPUESTAS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

Large handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.



B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

No	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p><b>REGLÓN 2 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN</b></p> <p>DICE: 1.5 FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE HASTA DOS HORAS O QUE PERMITA REALIZAR AL MENOS 40 REGISTROS IMPRESOS</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DURACIÓN DE BATERÍA DE 30 MINUTOS O AL MENOS 30 REGISTROS IMPRESOS, TIEMPO Y REGISTROS SUFICIENTES PARA QUE LA PLANTA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRE EN FUNCIONAMIENTO, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO CLÍNICO ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES</p>
2	<p><b>REGLÓN 2 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN</b></p> <p>DICE: 2.2 AJUSTE DE SENSIBILIDAD Y VELOCIDAD: AL MENOS TRES VELOCIDADES DIFERENTES, INCLUYENDO 25 Y 50 MM/SEG.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE EL AJUSTE DE VELOCIDAD DE 25 Y 50 MM/SEG, CARACTERÍSTICA SUFICIENTE PARA OBTENER UN ECG DE 12 DERIVACIONES EN CALIDAD CLÍNICA, ¿SE ACEPTA NUESTRA TECNOLOGÍA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.</p>
3	<p><b>REGLÓN 2 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN</b></p> <p>DICE: 5.2 SOFTWARE INTERPRETATIVO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATAL.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> EL ESPACIO PARA COLOCAR 10 ELECTRODOS EN EL TORAX DE UN PACIENTE NEONATAL ES BASTANTE REDUCIDO POR LO QUE PUEDE DIFICULTAR LA PREPARACIÓN DEL MISMO PARA UN ESTUDIO DE ECG, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN SOFTWARE CON CAPACIDAD INTERPRETATIVA PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.</p>

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page]*



4	<p><b>RENGLÓN 2 ELECTROCARDIOGRAMA MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN</b></p> <p>DICE: 5.3 FUNCIÓN DE CALIPER O COMPÁS PARA MEDICIÓN MANUAL DE LOS INTERVALOS DEL ECG</p> <p><b>PREGUNTA:</b> LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE LA IMPRESIÓN EN CALIDAD DIAGNÓSTICA DEL TRAZO DE 12 DERIVACIONES, DE IGUAL MANERA SE OFRECE INFORMACIÓN DE CADA ONDA Y UNA INTERPRETACIÓN QUE ORIENTA AL USUARIO RESPECTO AL DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE. DE SER NECESARIA ALGUNA MEDICIÓN ADICIONAL, ESTA SE PUEDE REALIZAR SOBRE LA IMPRESIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.
5	<p><b>RENGLÓN 2 ELECTROCARDIOGRAMA MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN</b></p> <p>DICE: 5.4 ANÁLISIS DE POTENCIALES TARDÍOS Y SEÑAL PROMEDIADA DE LA ONDA P.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE EL ANÁLISIS DE RETRASOS DE LA CONDUCCIÓN AV Y RETRASO DE LA CONDUCCIÓN INTRAVENTRICULAR, TAMBIÉN SE OBTIENEN EL VALOR DE ONDA P FRONTAL, Y CON ESTAS CARACTERÍSTICAS SE CUBRE LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA TECNOLOGÍA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
6	<p><b>RENGLÓN 2 ELECTROCARDIOGRAMA MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN</b></p> <p>DICE: 5.6 MEDICIÓN DE LA DISPERSIÓN QT</p> <p><b>PREGUNTA:</b> LA TECNOLOGÍA A OFERTAR PERMITE EL DESPLIEGUE DEL INTERVALO QT, QT CORREGIDO SEGÚN LA FRECUENCIA DE BAZETT, QT CORREGIDO SEGÚN LA FRECUENCIA DE FRIDERICIA, AMPLIANDO LAS CAPACIDADES DE DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO PARA EL INTERVALO QT, Y CON ESTA TECNOLOGÍA SE CUBRE Y SE EXCEDE LOS SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA TECNOLOGÍA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
7	<p><b>RENGLÓN 2 ELECTROCARDIOGRAMA MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN</b></p> <p>DICE: 5.7 SOFTWARE INTERPRETATIVO PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL O EQUIVALENTE EN DÍAS O PESO.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> EL ESPACIO PARA COLOCAR 10 ELECTRODOS EN EL TORAX DE UN PACIENTE NEONATAL ES BASTANTE REDUCIDO POR LO QUE PUEDE DIFICULTAR LA PREPARACIÓN DEL MISMO PARA UN ESTUDIO DE ECG, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN SOFTWARE CON CAPACIDAD INTERPRETATIVA PARA PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO, ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.



8	<p><b>RENLÓN 10 OXÍMETRO DE PULSO</b></p> <p><b>PUNTO 2. DESPLIEGUE EN PANTALLA LCD O LED</b></p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON PANTALLA LCD TOUCHSCREEN, PARA FACILITAR Y AGILIZAR EL MANEJO DE LOS USUARIOS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
9	<p><b>RENLÓN 10 OXÍMETRO DE PULSO</b></p> <p><b>PUNTO 4.3. BARRA Y VALOR NUMÉRICO DE PERFUSIÓN Y/O PULSO.</b></p> <p>PREGUNTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACEPTE Y MODIFIQUE OFERTAR EQUIPO CON MAYOR TECNOLOGÍA QUE MUESTREN EL ÍNDICE DE PERFUSIÓN DE MANERA NUMÉRICA CON UN RANGO DE VISUALIZACIÓN DE 0.0 A 20 YA QUE ES MUCHO MÁS PRECISO QUE LA BARRA DE PERFUSIÓN, DE ESTÁ MANERA SE PUEDE BRINDAR A LOS PACIENTES UNA MEJOR MONITORIZACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
10	<p><b>RENLÓN 10 OXÍMETRO DE PULSO</b></p> <p><b>PUNTO 5.2. RANGO ALTO DE 70 A 100 +/- 3%</b></p> <p>PREGUNTA. SE SOLICITA SE ACEPTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE Y MODIFIQUE OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR CON PRECISIÓN DE LA SEÑAL CON UNA DESVIACION MÁXIMA DE LA MEDICION SIN MOVIMIENTO DEL 2%,CON UNA DESVIACION MÁXIMA CON MOVIMIENTO DEL 3% Y CON UNA DESVIACION MÁXIMA CON BAJA PERFUSIÓN DEL 2%. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PARTICIPACIÓN DE ESA TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
11	<p><b>RENLÓN 10 OXÍMETRO DE PULSO. PUNTO 4.5.</b></p> <p><b>PREGUNTA.</b> SE SOLICITA LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR CON TENDENCIAS DE 80 HR O MÁS, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>
12	<p><b>RENLÓN 10 OXÍMETRO DE PULSO. PUNTO. 10.</b></p> <p>DICE. QUE REALICE PRUEBA DE AUTOFUNCIONAMIENTO.</p> <p>PREGUNTA. DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA EQUIPO, LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO SE PUEDE REALIZAR DURANTE EL ENCENDIDO DEL EQUIPO, EN BASE A LO ANTERIOR, ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE TECNOLOGÍA QUE MANEJE EL AUTOPRUEBA DE ENCENDIDO DEL EQUIPO CON LA FINALIDAD DE PODER PREVENIR E IDENTIFICAR ALGUNA FALLA DEL EQUIPO ANTES DE SU USO?, ¿SE ACEPTA NUESTRA SUGERENCIA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the table]*

*[Large handwritten signature in blue ink at the bottom right]*



13	<p><b>RENGLÓN 10 OXÍMETRO DE PULSO. PUNTO 14.</b></p> <p><b>PREGUNTA.</b> SE SOLICITA LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR CON BATERÍA RECARGABLE INTERCONSTRUIDA QUE PERMITA UNA DURACIÓN DE 5 HORAS O MÁS, ESTO LE PERMITE AL USUARIO SU TRANSPORTABILIDAD DE MOVER EL EQUIPO Y NO A LOS PACIENTES, AGILIZANDO SUS ACTIVIDADES Y SER MAS PRODUCTIVOS DURANTE SU TURNO Y CON PACIENTES MEJOR ATENDIDOS ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
14	<p><b>RENGLÓN 10 OXÍMETRO DE PULSO. PUNTO 16.</b></p> <p><b>PREGUNTA.</b> DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD LA TECNOLOGIA VAN AVANZANDO Y CAMBIANDO DE MANERA MUY RÁPIDA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE Y MODIFIQUE CON CAPACIDAD DE CONECTIVIDAD VÍA WIFI O BLUETOOTH, PARA AGILIZAR LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN Y QUE FAVOREZCA Y AYUDE A LOS USUARIOS A HACER MAS FÁCIL Y PRODUCTIVAS SUS LABORES ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA LA PARTICIPACIÓN DE ESA TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

**2.-PROVEEDOR: GRUPO MOBS S.A. DE C.V.**

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	<p>NUMERAL 7.2.12: ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS FOTOCOPIAS DE CERTIFICADOS/REGISTROS MENCIONADAS EN ESTE PUNTO SE ACREDITAN CON ANEXARLAS EN EL PUNTO 7.2.6 "ANEXO 2" DE LA PROPUESTA TÉCNICA, SIN DETRIMENTO DE PRESENTAR LA CARTA BAJO PROTESTA DE CUMPLIMIENTO QUE ESTABLECE ESTE NUMERAL, FAVOR DE ACLARAR</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	<p>NUMERAL 7.2.15: SE CONSULTA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE CON "ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS" SE REFIERE EL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. FAVOR DE ACLARAR</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3	<p>NUMERAL 7.2.29: EN EL APARTADO DE NOTA IMPORTANTE: CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, ASÍ COMO EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR ADICIONALMENTE A SU PROPUESTA POR ESCRITO, EN MEMORIA USB, LA PROPUESTA TÉCNICA EN PROGRAMA EXCEL DE OFFICE 2003-2007. SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR</p>	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES





	LA PROPUESTA TÉCNICA EN EL PROGRAMA WORD DE OFFICE ¿SE ACEPTA?	
4	NUMERAL 7.3.2: ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL ANEXO 12 SE TENDRÁ QUE DESCRIBIR TEXTUALMENTE "DE MANERA CLARA Y PRECISA", LO QUE ESTABLECEN LAS BASES RESPECTO DE LOS INCISOS A, B, C, D, E, F. FAVOR DE ACLARAR	SE PUEDE INDICAR LA LEYENDA "CONFORME A BASES"

B). - DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	REPUESTAS
1	ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN FICHA NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL PRODUCTO O INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, FAVOR DE ACLARAR.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
2	<b>RENLÓN 1 CARDIOTOCÓGRAFO.</b> PUNTO 7, DICE RANGO DE LA SEÑAL PARA TOCOTRANSDUCTOR DE 0-100 UNIDADES SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN CARDIOTOCÓGRAFO CON UN RANGO DE LA SEÑAL PARA TOCOTRANSDUCTOR DE 0-99 UNIDADES POR MINUTO. YA QUE NO DEMERITA SU FUNCIONALIDAD ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
3	<b>RENLÓN 1 CARDIOTOCÓGRAFO.</b> PUNTO 8, DICE DESPLIEGUE GRAFICO Y NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL: EN LATIDOS /MINUTOS CON UN RANGO DE 50 O MENOR A 240 O MAYOR. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN CARDIOTOCÓGRAFO CON UNA FRECUENCIA CARDIACA FETAL DE 50 A 210 LATIDOS POR MINUTO. YA QUE NO DEMERITA SU FUNCIONALIDAD ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
4	<b>RENLÓN 4 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE</b> PUNTO 6, CAPSULA PEQUEÑA DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE CON UNA CAPSULA PEQUEÑA DE 3.6 CM. YA QUE NO DEMERITA SU FUNCIONALIDAD ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES,
5	<b>RENLÓN 4 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE</b> PUNTO 5.2, ANILLO DE GOMA, SILICÓN O PLÁSTICO GRADO MEDICO CON ROSCA SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE CON ANILLO DE GOMA DE GRADO MEDICO SIN ROSCA YA QUE ESTO NO	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.



	DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	
6	<b>RENGLÓN 12 MESA PASTEUR</b> PUNTO 5, RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, RUEDA DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101.1MM (4") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UNAS RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO, CON RUEDAS DE HULE NATURAL COLOR NEGRO DE 101.1MM (4") DE DIÁMETRO; ACABADO GALVANIZADO, TODA VEZ QUE EL ACABADO PROPUESTO CUENTA CON MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
7	<b>PREGUNTA GENERAL PARA INSTRUMENTAL MEDICO</b> TODA VEZ QUE EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2003 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA DECIMOCUARTA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO [HTTP://DOF.GOB MX/NOTA DET ALLE.PHP?CODIGO=6884 77&FECHA=01/10/2003L EN EL CUAL SE MENCIONA QUE ES PERMITIDA UNA TOLERANCIA DE +/-10% EN LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA OFERTAR INSTRUMENTAL MÉDICO CON UN RANGO DE TOLERANCIA DE +/-10% EN LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
8	<b>RENGLÓN 2 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN</b> PUNTO 5.1, REFERENTE A LAS MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LOS INTERVALOS DEL ECG SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS MEDICIONES QRS, QT/QTc, Y EJES P/QRS/T ¿ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
9	<b>RENGLÓN 2 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN</b> SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS PERMITA CONSIDERAR EL PUNTO 5.3 YA QUE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA ¿ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO ES CLARA ESTA PREGUNTA, YA QUE NO SE DESCRIBE LA CONSIDERACIÓN SOLICITADA.
10	<b>RENGLÓN 2 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN</b> SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS PERMITA CONSIDERAR EL PUNTO 5.4 YA QUE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA ¿ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO ES CLARA ESTA PREGUNTA, YA QUE NO SE DESCRIBE LA CONSIDERACIÓN SOLICITADA.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

Large handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



11	<b>RENGLÓN 2 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN</b> SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS PERMITA CONSIDERAR EL PUNTO 5.5 YA QUE LIMITA LA LIBRE COMPETENCIA ¿ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	NO ES CLARA ESTA PREGUNTA, YA QUE NO SE DESCRIBE LA CONSIDERACIÓN SOLICITADA.
12	<b>Renglón 9 monitor de signos vitales</b> En relación al punto 19 referente al sistema de fijación y de traslado, SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS aclare cuantas piezas se requieren sistema de fijación y cuantas piezas se requieren para carro de traslado ¿favor de aclarar?	SE ACLARA QUE POR CADA EQUIPO SE REQUIERE UN SOPORTE RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS.

**1. PROVEEDOR: DICIPA S.A. DE C.V.**

No.	Preguntas	Respuestas
1	Dice: <b>PUNTO 1.- DE LA ESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACION, CONDICIONES Y FECHA DE ENTREGA</b> 1.5 El (los) participante (s) a quien (es) se le (s) adjudique (n) el (las) contrato (s) derivado (s) de la presente licitación, deberá (n) realizar la entrega e instalación de los bienes descritos, así como la puesta en marcha y capacitación al personal usuario de aquellos equipos que así lo ameriten, dentro de los 7 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  <b>Pregunta:</b> Solicitamos a la amable convocante extender el tiempo de entrega a un periodo de 60 días naturales una vez siendo adjudicado él licitante. ¿se acepta?	NO SE ACEPTA APEGARSE A BASES
2	Dice: <b>Punto 7.2 Propuesta Técnica</b> PUNTO 7.2.6.- Para los bienes ofertados, se deberá agregar a la propuesta los registros sanitarios vigentes o DOF según sea el caso, así como certificado de buenas prácticas de fabricación y certificados de calidad de manufactura vigentes de país de origen. Debidamente referenciadas y legibles en los cuatro ángulos, con demás anexos legales administrativos y técnicos, en caso de ser necesario con respecto a los certificados de calidad, tendrán que anexar traducción simple en idioma español.  <b>Pregunta:</b> Es correcto entender que en este punto se cumplirá agregando en el anexo 2, los datos del registro sanitario y certificado de calidad, y que la fotocopia simple de estos documentos será agregada en el punto 7.2.12 ¿Es correcta nuestra apreciación?	LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ANEXARSE EN EL NUMERAL 7.2.6.

3	Dice: <b>Punto 7.2 Propuesta Técnica</b> PUNTO 7.2.24.- los licitantes deberán anexar como mínimo fotocopias legibles de 2 contratos formalizados con cualquier Entidad Pública o Privada, ya sea Dependencia de	SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES
---	---	--



<p>esta u otra Entidad Federativa, por la venta de bienes de características iguales a las descritas en anexo técnico y fichas técnicas, es importante mencionar que será de acuerdo a los renglones en los que participe</p> <p><b>Pregunta:</b> Solicitamos a la amable convocante con la finalidad de no limitar la libre participación, que los contratos solicitados puedan ser de equipos con características similares. ¿se acepta?</p>	
--	--

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

No.	Preguntas	Respuestas
1	<p><b>Renglón 9 Monitor de signos vitales</b></p> <p><b>Dice:</b> 19. Sistema para fijación de cada monitor: Montaje de pared y soporte rodable con sistema de frenos.</p> <p><b>Pregunta:</b> Con la finalidad de permitir mayor movilidad y facilitar el traslado de pacientes con monitor de signos vitales, sugerimos a la convocante considere el soporte rodable como sistema de fijación para todos los monitores de signos vitales solicitados, ¿se acepta?</p>	<p>Se acepta, sin ser limitante para los demás participantes. Se aclara que solo se requiere por cada equipo un soporte rodable con sistema de frenos, sin el montaje a pared.</p>
2	<p><b>Renglón 9 Monitor de signos vitales</b></p> <p><b>Dice:</b> 24. Capacidad a futuro de medición y visualización de capnografía y gasto cardiaco.</p> <p><b>Pregunta:</b> Solicitamos a la convocante nos permita ofertar solo la capacidad a futuro de capnografía, parámetro suficiente para iniciar mediciones avanzadas y que el paciente sea trasladado a áreas más especializadas con equipos avanzados. ¿se acepta?</p>	<p>No se acepta, apegarse a lo solicitado en bases.</p>
3	<p><b>Renglón 9 Monitor de signos vitales</b></p> <p><b>Dice:</b> 25.1 Un cable troncal y dos sensores tipo dedal, reusable, para oximetría de pulso</p> <p><b>Pregunta:</b> Considerando que el cable troncal de oximetría de pulso es el mismo para paciente adulto, pediátrico y neonatal, entonces entendemos que el cable troncal solicitado en el punto 25.1 es el mismo cable troncal solicitado en el punto 26.1, solicitando un total de 1 cable troncal por monitor ¿es correcto?</p>	<p>El total de cables troncales que se solicitan por equipo son dos, uno para pacientes adulto/pediátrico y otro para paciente neonatal, esto independientemente de la tecnología ofertada.</p>
4	<p><b>Renglón 9 Monitor de signos vitales</b></p> <p><b>Dice:</b> 25.2 Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie)</p> <p><b>Pregunta:</b> Considerando que el sensor de temperatura es el mismo para paciente adulto, pediátrico y neonatal, entonces entendemos que sensor solicitado en el punto 25.2 es el mismo que se solicita en el punto 26.2, solicitando un total de 1 sensor de temperatura por monitor ¿es correcto?</p>	<p>El total de sensores que se solicitan por equipo son dos, uno para pacientes adulto/pediátrico y otro para paciente neonatal, esto independientemente de la tecnología ofertada.</p>



CONCLUYE LA ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA. -----

RESPECTO A LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, **MANIFIESTAN NO TENER OBJECCIÓN ALGUNA, ACEPTANDO LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES FIRMANDO DE CONFORMIDAD.**-----

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE TRES DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://www.ssaver.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2022/> -----

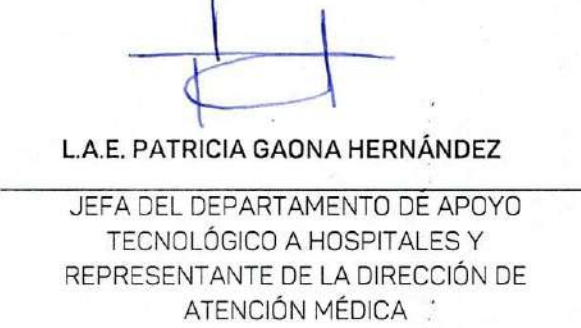
5.- EN DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CINCO , FINALMENTE SE REITERA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **07 DE DICIEMBRE DEL 2022, A LAS 10:00 HORAS**, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE ESTOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, SITO EN SOCONUSCO NO. 31, COL. AGUACATAL, C.P. 91130 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **ONCE HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO NO INVALIDA EL CONTENIDO DE LA MISMA.-----

-----  
POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

  
LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA  
-----  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

  
C.P.A. VERÓNICA RAMON CORTINA  
-----  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
L.A.E. PATRICIA GAONA HERNÁNDEZ  
-----  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO  
TECNOLÓGICO A HOSPITALES Y  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE  
ATENCIÓN MÉDICA

  
LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA  
-----  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA



L.C. YADIRA MONSERRAT TORRES SÁNCHEZ

COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

LIC. ZAIDA ELIZABETH ESCOBAR RICO

COTIZADORA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
MTRA. MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS	REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	
MTRO. GUILLERMO RAMÓN HERNÁNDEZ		

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	FIRMA
DICIPA S.A. DE C.V.	C. MIGUEL ÁNGEL BRIONES HERNÁNDEZ	
CONDUIT LIFE S.A. DE C.V.	C. DANIEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ	
GRUPO MOBS S.A. DE C.V.	C. JOSÉ MARÍA TAGANO RUIZ	

\*\*\*\*\*FIN DEL ACTA\*\*\*\*\*