




AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: AUTOCLAVE ELECTRÓNICO DIGITAL 12 LITROS	

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	<p>DIMENSIONES EQUIPO: ANCHO: 30 CM. ALTURA: 30 CM. LARGO: 51.8 CM. DIMENSIONES CÁMARA: ANCHO: 54 CM. ALTURA: 29 CM. LARGO: 33 CM.</p> <p>DIMENSIONES DE CHAROLAS : CHAROLA (3): 30X14 CM</p> <p>ELÉCTRONICO: ALIMENTACIÓN: 120V~/60HZ.</p> <p>POTENCIA: 800W.</p> <p>FUSIBLE: 0.5A AMERICANO</p> <p>PROGRAMA DE TIEMPO: RANGO DE 10-99 MINUTOS.</p> <p>PROGRAMA DE TEMPERATURA: RANGO DE 100°-180° C.</p> <p>CUERPO DEL EQUIPO PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA PARA DAR UN ACABADO DURADERO Y DE CALIDAD</p> <p>AUTO-SELLADO CON SELLO DE SILICÓN GRADO HIGIÉNICO.</p> <p>PANTALLA LCD BRINDA MAYOR CONTROL PARA MONITOREAR EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN</p> <p>CÁMARA INTERNA HECHA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 30 FORCEPS.</p> <p>REQUIRE REGISTRO SANITARIO</p> <p>REQUIERE CERTIFICADO DE LAS BUENAS PRÁCTICA EMITIDO POR LA COFEPRIS.</p> <p>NORMA ISO 9001-2000</p> <p>NORMA ISO 13485 - 2003</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES</p>	5
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO: RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO: BAÑO DE FLOTACIÓN	CANTIDAD OFERTADA:

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	<p>SUPERFICIE QUE PROPORCIONA ALTAS TASAS DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA</p> <p>RANGO DE TENSIÓN DE TEMPERATURA: ENTRE AMBIENTE Y LOS 75 °C.</p> <p>ALTURA DE SERVICIO: COMO MÁXIMO 2000 M SOBRE EL NIVEL DEL MAR.</p> <p>CLASE DE PROTECCIÓN IP (IEC 60529): IP 20</p> <p>TENSIÓN NOMINAL: DOS AJUSTES DE FÁBRICA NO MODIFICABLES: 100-120 V CA +10% 230-240 V CA +10%</p> <p>FRECUENCIA NOMINAL: 50/60 HZ</p> <p>POTENCIA NOMINAL: 350 VA</p> <p>FUSIBLE PRINCIPAL: 2 FUSIBLES, 5 X 20 MM, CON HOMOLOGACIÓN UL</p> <p>PARA 100-120 V: 5 X 20 MM, 2X T 5 A L250 V CA</p> <p>PARA 230-240 V: 5 X 20 MM, 2X T 2,5 A L250 V CA</p> <p>MEDIDAS: 350 X 310 X 100 MM</p> <p>PESO VACÍO: 3,6 KG (SIN EMBALAJE)</p> <p>HUMEDAD RELATIVA: 20-80%, SIN CONDENSACIÓN</p> <p>CLASIFICACIÓN CONFORME A IEC 1010: CLASE DE PROTECCIÓN: 1</p> <p>GRADO DE CONTAMINACIÓN 2</p> <p>CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN: II</p> <p>GARANTÍA 24 MESES</p>	1




ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO:
	PROCESO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: CENTRÍFUGA	

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	<p>ACOMODA ROTORES DE CITOLOGÍA CERRADOS QUE PUEDEN EQUIPARSE CON HASTA DOCE CLIPS PARA CITOLOGÍA</p> <p>LOS ROTORES CERRADOS SE CARACTERIZAN POR SUS EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD</p> <p>SON FÁCILES DE DESMONTAR PARA QUE LA CARGA Y DESCARGA PUEDA REALIZARSE BAJO LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR ESTO PROTEGE A LOS USUARIOS Y A LAS MUESTRAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA CENTRIFUGACIÓN</p> <p>LA CENTRÍFUGA AHORRA ESPACIO EN EL LABORATORIO DEBIDO A SU PERFIL COMPACTO Y A LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR ROTORES ABATIBLES SELECCIONADOS ADEMÁS DE LOS ROTORES DE CITOLOGÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE CÉLULAS EN LA MISMA CENTRIFUGADORA</p> <p>CON SU VELOCIDAD MÁXIMA DE 2.000 MIN-1 Y LOS DOS PERFILES DE ACELERACIÓN Y FRENADO, ESTÁ PERFECTAMENTE EQUIPADA PARA LA CENTRIFUGACIÓN DE MUESTRAS DE CITOLOGÍA Y CÉLULAS SENSIBLES.</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	1

ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 60	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CONGELADOR HORIZONTAL DE 5 PIES.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	<p>CONGELADOR HORIZONTAL DE 5 PIES  UNA SOLA PUERTA LISA, SOLIDA Y TIPO COFRE.  PUERTA CON EMPAQUE MAGNÉTICO Y SELLADO HERMÉTICO.  PUERTA CON AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO DE 45 MM DE ESPESOR, CON DENSIDAD DE 38 A 40 KG/M3  PUERTA CON CERRADURA Y LLAVE EXTERNA EVITANDO EL CONTACTO CON LA PARTE INTERNA SIN PARTES FILOSAS O REBABAS.  GABINETE CON AISLAMIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADA EN SITIO 45 MM DE ESPESOR, CON DENSIDAD DE 38 A 40 KG/M3  GABINETE CON PANELES INTERNOS LISOS  ESQUINAS REDONDAS QUE PERMITEN UNA MEJOR LIMPIEZA EN EL EQUIPO.  RANGO DE TEMPERATURA INTERNA DE -15°C A -30°C ÁUN EN AMBIENTES DE 42°C.  THERMOSTATO ELECTROMECAÁNICO QUE PERMITE REGULAR LA TEMPERATURA DEL EQUIPO.  CON 4 RUEDAS CON FRENOS QUE PERMITEN MOVER FÁCILMENTE EL EQUIPO.  COLOR BLANCO.  SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BASADO EN PAREDES ACTIVAS BRINDANDO UNA TEMPERATURA UNIFORME Y MÁXIMA EFICIENCIA EN CONSUMO ENÉRGETICO.  TAPON DE DRENAJE PARA DESCONGELACIÓN  COMPRESOR Y CONDENSADOR SELLADOS HERMETICAMENTE, SILENCIOSOS Y DE BAJO MANTENIMIENTO.  VOLTAJE: 115 V, 60 HZ.</p>	60



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 60	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CONGELADOR HORIZONTAL DE 5 PIES.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>DEBERÁ CONTAR CON UNA CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE REMOVIBLE</p> <p>DEBERÁ ENTREGARSE CON EL MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL, SE SOLICITA CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES.</p> <p>NORMA ISO 9001-2015 GARANTIA 24 MESES</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.848.0013	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO A TRAVÉS DE EMISIONES OTOACÚSTICAS Y POTENCIALES AUDITIVOS AUTOMATIZADOS.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<p>EQUIPO QUE SIRVE PARA REALIZAR PRUEBAS OBJETIVAS DE TAMIZ AUDITIVO A RECIÉN NACIDOS, NIÑOS Y ADULTOS.</p> <p>CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO AUTOMATICO, PORTATIL DE MANO PARA REALIZAR PRUEBAS AUDITIVAS EN AMBOS OÍDOS. PESO NO MAYOR DE 600 GRAMOS. CON PROCESO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE FORMA AUTOMÁTICA. DESPLIEGUE DE RESULTADOS EN PANTALLA LCD. BOTONES O TECLAS PARA MANEJO DEL EQUIPO. CON CAPACIDAD DE REALIZAR PRUEBAS POR MEDIO DE: ABR O PEAA (POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS AUTOMATIZADOS) Y DPOAE O EOAPD (EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN) Y/OTEOAE O EOAT (EMISIONES OTOACÚSTICAS POR TRANSITORIOS).</p> <p>RESULTADOS AUTOMÁTICOS SIN NECESIDAD DE INTERPRETACIÓN. PASS (APTO). REFER (NO APTO). AMPLITUD MÁXIMA DEL ESTÍMULO PARA: EMISIONES OTOACÚSTICAS POR TRANSITORIOS 84 DB SPL. EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN 70 DB SPL. ABR O PEAA DE 35 A 45 DB NHL, COMO MÍNIMO EN PASOS DE 5 DB NHL.</p>	2

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.848.0013	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO A TRAVÉS DE EMISIONES OTOACÚSTICAS Y POTENCIALES AUDITIVOS AUTOMATIZADOS.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>RANGO MÍNIMO DE FRECUENCIAS DE PRUEBA O ANCHO DE BANDA: PARA EMISIONES OTOACÚSTICAS POR TRANSITORIOS DE 0.7KHZ.A 4KHZ. Y PARA EMISIONES OTOACÚSTICAS POR PRODUCTOS DE DISTORSIÓN 2KHZ. A 4KHZ. ABR O PEAA DE100 HZ A 3000HZ. QUE PERMITA ELEGIR LA PRUEBA A REALIZAR: EMISIONES OTOACÚSTICAS Y/O POTENCIALES EVOCADOS. CON TASA DE ESTIMULACIÓN PARA POTENCIALES EVOCADOS POR CLICKS ENTRE 30 Y 60 POR SEGUNDO. MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE LA IMPEDANCIA. CRITERIO DE PASE AUTOMATIZADO. CAPACIDAD DE ALMACENAR 50 PRUEBAS COMO MÍNIMO EN MEMORIA INTERNA DE LA UNIDAD DESPLIEGUE DE INFORMACIÓNEN IDIOMA ESPAÑOL. INTERFASE PARA DESCARGAR DATOS A COMPUTADORA Y/O IMPRESORA. SOFTWARE DE BASE DE DATOS PARA MANEJO EN EQUIPO DE CÓMPUTO. ALARMAS O AVISOS VISIBLES DE AMBIENTE RUIDOSO, ALTA IMPEDANCIA, MALA COLOCACIÓN Y BATERÍA BAJA. QUE FUNCIONE CON BATERÍAS RECARGABLES. QUE INCLUYA CARGADOR Y PILAS ACORDE AL MODELO DEL EQUIPO.</p>	

*[Handwritten signature]*



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 3 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.848.0013	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO A TRAVÉS DE EMISIONES OTOACÚSTICAS Y POTENCIALES AUDITIVOS AUTOMATIZADOS.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>QUE INCLUYA CABLE DE SONDA PARA PRUEBAS DE AL MENOS 1 METRO DE LONGITUD</p> <p>QUE INCLUYA MALETÍN DE TRANSPORTE EN MATERIAL DURABLE, SONDA Y REPUESTO DE PUNTA DE SONDA.</p> <p>QUE INCLUYA CABLE O CABLES PORTA ELECTRODOS PARA PRUEBAS DE POTENCIALES EVOCADOS</p> <p>QUE INCLUYA HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA O DISPOSITIVO PARA LIMPIEZA DE LA SONDA, IMPRESORA TÉRMICA. PC O LAPTOP CON REGULADOR DE VOLTAJE PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN</p> <p>QUE INCLUYA ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA TÉRMICA, QUE INCLUYA OLIVA EN DIFERENTES TAMAÑOS, ELECTRODOS DESECHABLES, BATERIAS RECARGABLES, GEL LIMPIADOR.</p> <p>CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V +/- 10%,60HZ.</p> <p>CAPACITACIÓN EN USO DEL EQUIPO</p> <p>QUE CUMPLA LA NORMA ISO 13485:2016</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES</p>	

*[Handwritten signature]*






AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 4 DE 4
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 2	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.848.0013	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO PORTÁTIL PARA TAMIZ AUDITIVO A TRAVÉS DE EMISIONES OTOACÚSTICAS Y POTENCIALES AUDITIVOS AUTOMATIZADOS.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
		

ELABORÓ:		
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA 	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESCARIADOR CAVITRON ULTRASÓNICO LUZ LED 5 PUNTAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>FRECUENCIA 30kHz ± 3kHz  PRESIÓN DE AGUA 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)  PESO DE LA UNIDAD PRINCIPAL 1,7 kg.  DIMENSIÓN 13.7cm × 9.5cm × 21.3cm  FUENTE DE LUZ DE LA LAMPARA: LED  DISEÑO DE LA MANIJA SELLADA  INCLUYE:  PIEZA DE MANO  MOTOR  3 FUNDAS ( MORADO, VERDE Y AZUL )  PEDAL  5 PUNTAS Y LLAVE.  CERTIFICADO POR FDA Y NSF.  GARANTÍA 24 MESES.</p> 	5

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 17	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESFIGNOMANÓMETRO ANEROIDE


RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	<p>MANÓMETRO EN ESMALTE NEGRO 300MMHG                      BRAZAL DE NYLON CON SISTEMA DE MARCADO GUÍA DE TALLAS                      PROPIEDAD DE ADC                      CÁMARA DE DOS VÍAS DE SILICÓN                      PERILLA DE SILICÓN CON VÁLVULA DE PURGA EN LATÓN CROMADO                      VÁLVULA DE SEGURIDAD                      ESTUCHE DE CUERO CON CIERRE GRANDE, FACIL DE LEER,                      CARATULA DE 5.00 CM, LA CARATULA CON FONDO BLANCO Y SUS                      NÚMEROS NEGROS HACEN QUE LA VISIBILIDAD SEA INMEJORABLE.                      EL MOVIMIENTO DE MEDICIÓN CON INTERVALOS DE 20 MMHG Y                      RANGO DE 20 A 300 MMHG RESISTE EL USO MAS PESADO                      GARANTIA DE 24 MESES                      NORMA ISO 9001-2000                      NORMA ISO 13485-2003                      REQUIERE REGISTRO SANITARIO</p> 	17
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 31	MODELO:
CLAVE S.S: 531.375.0126	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	<p>ARCO Y AURICULARES DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, ERGONÓMICOS Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO.</p> <p>OLIVAS LAVABLES FABRICADAS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON TUBO FLEXIBLE.</p> <p>LONGITUD DE 50 CM O MÁS</p> <p>CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN, CON SISTEMA DE ROTACIÓN O GIRO PARA EL CAMBIO DE CÁPSULA</p> <p>MEMBRANA PARA CÁPSULA CON ANILLO DE SUJECIÓN.</p> <p>CÁPSULA PEQUEÑA CON DIÁMETRO DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM.</p> <p>CÁPSULA GRANDE CON DIÁMETRO DENTRO DEL RANGO DE 4 A 4.5 CM</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	31

ELABORÓ: DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

REVISÓ: DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

AUTORIZÓ: DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA


FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA	

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	<p>VOLUMEN: 60 LITROS</p> <p>MEDIDAS. INTERIOR. 40 CM. x 44 CM x 34.5 CM</p> <p>-CANTIDAD DE BANDEJAS (EST./MÁX.) 2/4</p> <p>-120V 1~ 60 HZ - 12.5 A</p> <p>FUNCIÓN DE RAMPA</p> <p>APAGADO PROGRAMABLE POR TIEMPO</p> <p>ENCENDIDO PROGRAMABLE POR TIEMPO</p> <p>APAGADO PROGRAMABLE POR TIEMPO Y TEMPERATURA</p> <p>DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CLASE 2</p> <p>ALARMA VISUAL DE TEMPERATURA</p> <p>RANGO DE TEMPERATURA: DESDE 10 °C POR ENCIMA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 300 °C</p> <p>CONVECCIÓN FORZADA</p> <p>CONTROLADOR CON PANTALLA LCD</p> <p>REGULACIÓN DE LA REJILLA DE AIRE DE SALIDA POR CONTROL ELECTROMECAÁNICO</p> <p>2 REJILLAS CROMADAS</p> <p>POSIBILIDAD DE APILAR EQUIPOS DE HASTA 115 L</p> <p>DISPOSITIVO INTEGRADO DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA CON AJUSTE INDEPENDIENTE DE CLASE 2 (DIN 12880) Y ALARMA ÓPTICA</p> <p>DISEÑO ERGONÓMICO DE LA MANILLA</p> <p>CONEXIÓN USB PARA EL REGISTRO DE LOS DATOS</p> <p>GARANTÍA 2 AÑOS</p> 	1
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - JEFA DE DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 53101	MARCA:	
CANTIDAD: 4	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: JERINGA DE CALIBRACIÓN PARA ESPIROMETRO		
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	<p>TAMAÑO: 3 LITROS CILINDRO DE ALUMINIO COMPATIBLE CON ESPIROMETRO MODELO EASY ON NDD NORMAS ISO 13485. GARANTÍA DE 24 MESES</p> 	4
ELABORÓ:		
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 53101	MARCA:	
CANTIDAD: 5	MODELO:	
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA DE FOTOCURADO PARA RESINAS FOTOPOLIMERIZABLES		
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	<p>LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN LED, CON UNA INTENSIDAD DE LUZ DE 800 MW / CM2., UNIVERSAL CON OPERACIÓN DE 1 BOTÓN CON SONDA DE LUZ GIRATORIA DE 10 MM. FOTOPOLIMERIZABLES EN EL RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 430 - 490 NM. CON LENTES O GAFAS DE PROTECCION COLOR AMBAR PARA USUARIO Y PACIENTE. COFEPRIS O ISO 13485. GARANTIA DE 24 MESES</p> 	5
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MANDIL EMPLOMADO CON COLLARIN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	<p>CONTENIDO DEL KIT: MANDIL EMPLOMADO CON COLLARÍN PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS X</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPO DE CUELLO: REDONDO</li> <li>• MATERIAL PRINCIPAL: PLOMO</li> <li>• COMPOSICIÓN: PLOMO</li> </ul> <p>DESCRIPCIÓN: MANDIL EMPLOMADO AVALADA CONTRA RAYOS X, CON 0.5 MM DE PB DE PROTECCIÓN. HECHO A BASE DE TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, CON CIERRE DE VELCRO PARA AMARRE A LA CINTURA. DIMENSIONES APROXIMADAS 24 PULGADAS DE ANCHO X 38 PULGADAS DE LARGO. COFEPRIS Y / O ISO 9001:2008 Y 13485:2003 DEL FABRICANTE GARANTIA: 24 MESES</p> <div style="text-align: center;">  </div>	1
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA AUXILIAR MULTIIUSOS CON CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	<p>MESA AUXILIAR CON 4 RUEDAS, LLAVE ESPANOLA DE 12MM Y TORNILLERIA                      COLOR: PLATA                      LARGO DEL PRODUCTO: 68 CM                      ALTURA DEL PRODUCTO: 87 CM                      ANCHO DEL PRODUCTO: 40.5 CM                      PESO DEL PRODUCTO: 4.5 KG                      CALIBRE DE LA MESA: 0.8MM                      MEDIDA DE LAS BANDEJAS: 60 CM X 40 CM.                      COMPOSICIÓN: ACERO INOXIDABLE                      POR SEGURIDAD LA MESA DEBERA CONTAR CON FRENO EN CADA LLANTA DE LAS PATAS DELANTERAS. SIN ISO.                      GARANTIA: 24 MESES</p> 	5
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	<p>MESA PARA EXPLORACIÓN UNIVERSAL (GINECOLOGICA) ESTRUCTURA DE LAMINA COLOR ARENA, COJIN, BASTIDOR DE MADERA CON HULE ESPUMA DE 1.20* 0.55* 0.80 CM. (SSV-HRC-5401-101108)</p> <p>SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE CON CONTACTO Y CABLE CALIBRE NO. 20 DE 3.5 MTS. DE LONGITUD CON CLAVIJA INTEGRADA</p> <p>CUBIERTA DE TRES SECCIONES (RESPALDO, PIECERA Y ASIEN TO) CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, ACOJINAMIENTO EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 17KM/M3 DE DENSIDAD Y 2.0 CM. DE ESPESOR, ACABADO EN VINILO TIPO PIEL. ESTRUCTURA Y PUERTA ABATIBLE EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN ESMALTE.</p> <p>NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	1


ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 6	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MESA MAYO

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	<p>MESA FABRICADA EN ACERO CROMADO, INCLUYE CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE                      ARO PORTA-CHAROLA DE 2.54 (1") CALIBRE NO. 12 Y CHAROLA CALIBRE NO. 20 DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO                      PALANCA OPRESORA DE ACERO DE 8CM DE LARGO, ACABADO CROMADO. PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51MM (2" X 2") CALIBRE NO. 10, ACABADO CROMADO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE PLOMO O ACERO.                      RODAJA TIPO BOLA DE HULE COLOR NEGRO DE 50.8MM (2") DE DIÁMETRO. ACABADO CROMADO.                      REQUIERE CERTIFICADO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EMITIDO POR LA NORMA ISO 9001-2000                      NORMA ISO 13485-2003                      REQUIERE REGISTRO SANITARIO                      GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	6

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 3	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: PROCESO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICROSCOPIO PARA CAMPO CLARO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	<p>ESTATIVO FABRICADO EN ALUMINIO, REVOLVER DE 4 POSICIONES CON SOPORTE ANTICAIDA PARA FILTROS DE 32MM; PLATINA CON BORDES REDONDEADOS,, DIMENSIONES 185MM X 140MM, RECORRIDO DE PLATINA 26MM X 76MM, CUENTA CON CALIBRADOR VERNIER PARA COORDENADAS X/Y; CONDENSADOR TIPO ABBE CENTRABLE DE APERTURA NUMÉRICA DOBLE DE 0.9/1.25 OÍL CON RANURA PARA CONTRASTE DE FASE Y CAMPO OSCURO, CON INDICACIÓN DE AUMENTO PARA REGULAR APERTURA NUMÉRICA EN CADA AUMENTO, ENFOQUE AUTOAJUSTABLE CON CONTROLES PARA POSICIÓN BAJA, ENFOQUE MICROMÉTRICO POR ROTACIÓN 300MICRAS; ILUMINACIÓN LED: TEMPERATURA 6000K, CON UNA VIDA CON AJUSTE DE ILUMINACIÓN TIPO KOEHLER AJUSTABLE Y CENTRABLE ILUMINACIÓN ÚTIL DE 25.000HR, AJUSTE CONTINUO DE INTENSIDAD, TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO , RESISTENTE A LA ABRASIÓN, BOTONES DE ENFOQUE EQUILIBRADOS, APAGADO AUTOMÁTICO A LAS 2 HORAS (PUEDE ACTIVARSE / DESACTIVARSE), SOPORTE CONDENSADOR CENTRABLE Y ENFOCABLE TUBO BINOCULAR DE 45° CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS DE 52 A 75MM. CONDENSADOR TIPO ABBE 0.90 / 1.25, PAR DE OCULARES 10X/20 MM ENFOCABLES OBJETIVO N PLAN 10X/0.25 OBJETIVO N PLAN 100X1.25 ACEITE DE INMERSIÓN. CABLE US ATERRIZADO GARANTÍA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.</p> 	3

ELABORÓ: BIOL. ARTURO BÁEZ HERNÁNDEZ - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR

REVISÓ: DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

AUTORIZÓ: DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 13	MODELO:
	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO:
	PROCESO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
17	<p>CARACTERÍSTICAS:                      CABEZA BINOCULAR, INCLINADA A 45°.                      PLATINA CON PINZAS.                      DOS PLATINAS INTERCAMBIABLES: CRISTAL OPAO, PARA LUZ TRANSMITIDA Y DOBLE CARA BLANCO/NEGRO, PARA LUZ INCIDENTE.                      AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR 55 ~ 75 MM.                      ANILLO ANTIDERRAPANTE EN OBJETIVO Y TAPA.                      ESTATIVO, ROBUSTO, REFORZADO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR.                      ILUMINACIÓN CON INTERRUPTORES INDEPENDIENTES.                      ACCESORIOS INCLUIDOS                      ADAPTADOR CA/CD                      LLAVE DE AJUSTE                      FUNDA DE PLÁSTICO                      DATOS TÉCNICOS                      MODELO: VE-S1                      OCULARES: WF 10X/20 MM, CON PRISIONERO                      OBJETIVOS: SELECCIONABLES 2X/4X (20 Y 40 AUMENTOS TOTALES). PLATINA INTERCAMBIABLE DE 60 MM/ 2.3" DE DIÁMETRO, CRISTAL OPAO Y DOBLE CARA BLANCO/NEGRO.                      ENFOQUE: MACROMÉTRICO ANTIDERRAPANTE                      ILUMINACIÓN: LED TRANSMITIDA E INCIDENTE                      DIMENSIONES: 160 x 270 x 200 mm / 6.2" x 10.6" x 7.8"                      FUENTE DE ALIMENTACIÓN:                      3 BATERÍAS AA RECARGABLES DE 1.2V (INCLUIDAS),                      CA 110/240, 50/60 HZ,                      GARANTÍA DE 24 MESES                      CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN                      Y/O VICIOS OCULTOS</p> 	13

ELABORÓ:	BIOL. ARTURO BÁEZ HERNÁNDEZ - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MUEBLE RODANTE

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	<p>CUBIERTO CON FORMAICA Y FABRICADO EN MDF. PESO 20 KG. DIMENSIONES: 50 X 44 X 76 CM. CUATRO CAJONES CON JALADERAS Y UNA PUERTA CON MAYOR CAPACIDAD PARA ORGANIZAR EL MATERIAL. JALADERAS EN LOS LATERALES DERECHO E IZQUIERDO PARA FACILITAR EL DESLIZAMIENTO, COLOR INDISTINTO. GARANTIA 24 MESES</p> 	4

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: 531.667.0065	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19	<p>EQUIPO PORTÁTIL PARA REGISTRO Y CONTROL CONTINUO DEL NIVEL DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE Y LA FRECUENCIA DEL PULSO CON FINES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS. EQUIPO PORTÁTIL PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN UN DEDO O MULTISITIO Y CON REGISTRO DEL PULSO. DESPLIEGUE DIGITAL DE: PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE CON INTERVALO DE 0 A 100%. FRECUENCIA DE PULSO DENTRO DEL RANGO DE 18 A 300 PULSOS POR MINUTO. LED O BARRA DE COLOR PARA INDICAR LA CALIDAD DE LA SEÑAL DE PERFUSIÓN RECIBIDA. CON INDICADOR DE BATERÍA BAJA. MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 18 HORAS DE DATOS DEL PACIENTE COMO MÍNIMO. ALARMAS PROGRAMABLES AUDIBLES Y VISUALES ALTA Y BAJA. SPO2: FRECUENCIA DE PULSO QUE PERMITA LECTURAS EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y CON BAJA PERFUSIÓN. CON INTERFASE RS 232 PARA COMUNICACIÓN A COMPUTADORA. TECLADO PLANO DE MEMBRANA. CON INDICADOR DE BATERÍA BAJA. PESO MÁXIMO DE 550 GRAMOS. ESTUCHE PARA GUARDA DE OXÍMETRO Y SENSORES. GARANTÍA DE 24 MESES.</p> <p>REQUIERE CERTIFICADO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EMITIDO POR LA COFEPRIS.</p> <p>NORMA ISO 9001-2000</p> <p>NORMA ISO 13485-2003</p> <p>REQUIERE REGISTRO SANITARIO</p> 	5

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: REFRIGERADOR CHICO PARA LABORATORIO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20	<p>TIPO ARMARIO, CON 1 PUERTA DE CRISTAL, CON DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA ALTURA 835 MM ANCHURA 540 MM PROFUNDIDAD 597 MM 3 ESTANTES VOLUMEN BRUTO 200 L VOLUMEN NETO 120 L CONSUMO 0,75 KWH/24H NIVEL DE SONIDO 42 DB PESO 34 KG TEMPERATURA 2°C MIN / 8°C MAX GARANTÍA DE 12 MESES</p> 	1

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: SILLA DE RUEDAS CON DESCANSABRAZOS	

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
21	<p>SILLA DE RUEDAS NEUMÁTICA CON BRAZOS FlipUp, DESCANSAPIES ABATIBLES Y DESMONTABLES. DISEÑADA CON RESISTENTE ESTRUCTURA Y TAPICERÍA DE NYLON ACOJINADA CON RETARDANTE A LA FLAMA.</p> <p>DESCANSABRAZOS TIPO SPORT ERGONOMICO CON DISEÑO FLIP UP Y ACOGINADOS DE PU.</p> <p>LLANTA NEUMATICA XTREME DE 24" CON RIN DE ALUMINIO Y ARO MOTRIZ DE ACERO Y RUEDA DELANTERA SEMINEUMÁTICA DE 8" x 2".</p> <p>REFLEJANTES PARA RAYOS DE RUEDAS Y EN CHASIS TRASERO CERTIFICADO POR LA FDA.</p> <p>GARANTIA 24 MESES</p>	10



ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA SALVAESCALERAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
22	<p>SILLA SALVA ESCALERAS, CON RECORRIDO CURVO EN LA PARTE MEDIA, VERSIÓN PARA INTERIOR, GUIA DE ALUMINIO Y FIJACIÓN EN LOS ESCALONES. RECORRIDO DE LA ESCALERA HASTA 8 METROS (PLANTA BAJA, DESCANSO Y PLANTA ALTA). MAQUINARIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COMPLETAMENTE PREMONTADA, CON EL VEHÍCULO Y EL CONJUNTO GUÍA COMPLETAMENTE CABLEADOS. ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LA TRAYECTORIA RESPECTO A LA HORIZONTAL ENTRE 20º Y 45º, TIPO DE ACCIONAMIENTO: HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO INDIRECTO. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 230 V ± 5% MONOFÁSICO 50/60 HZ POSIBILIDAD DE OTRAS TENSIONES MONOFÁSICAS.</p> <p>CAPACIDAD VERSIÓN ESTANDAR: 137KG (HASTA 160KG CON OPCIÓN EXTRAPESO). VELOCIDAD: 0,12M/SEG. QUE INCLUYA ELEMENTOS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ANCLAJES VEHÍCULO CON PLATAFORMA PARA SILLA DE RUEDAS, CON BRAZOS DE PROTECCIÓN EN TODO EL CONTORNO, RAMPAS PLEGABLES EN LOS LATERALES DE ACCESO Y UNA CHAPA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA.</p> <p>MANDOS INTEGRADOS EN LA CARCASA SUPERIOR Y SITUADOS A UNA ALTURA ADECUADA PARA USUARIOS EN SILLA DE RUEDAS. QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: LLAVÍN DE HABILITACIÓN PARA RESTRINGIR EL USO. - PULSADORES DE SUBIDA Y BAJADA INDEPENDIENTES, CON INDICADOR LUMINOSO DE ACTUACIÓN. - PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA CON INDICADOR LUMINOSO DE ACTUACIÓN. - INDICADOR ACÚSTICO Y LUMINOSO DE SOBRECARGA. SE REQUIERE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN PARA SU USO Y PUESTA EN MARCHA. CARACTERÍSTICAS DEL ASIENTO: ASIENTO PLEGABLE EN VEHÍCULO PARA USUARIOS DE MOVILIDAD REDUCIDA SIN SILLA DE RUEDAS. FUNDA IMPERMEABLE PARA LA PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO EN SU POSICIÓN CONTRA EL AGUA. GARANTIA DE 24 MESES</p>	1

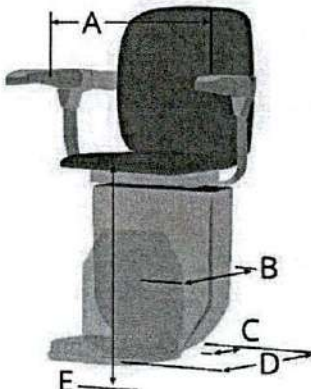






*[Handwritten signature]*

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SILLA SALVAESCALERAS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
A	ANCHURA DEL ASIENTO (DESDE EL REPOSABRAZOS)	48,2 CM	
B	DISTANCIA DE LA PARED AL REPOSAPIÉS (CERRADO)	40,5 CM (DEPENDE DE DÓNDE EMPIECE EL RECORRIDO DE LA SILLA)	
C	DISTANCIA DE LA PARED AL BORDE EXTERIOR DEL RIEL	15,2 CM*	
D	DISTANCIA DE LA PARED AL REPOSAPIÉS (ABIERTO)	67,9 CM*	
E	ALTURA DEL REPOSAPIÉS AL ASIENTO (NO AJUSTABLE)	47 CM	
	ANCHURA MÍNIMA DE LA ESCALERA	67,9-76,2 CM*	
    			
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES		
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES		
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA		


AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 886	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TERMÓMETRO DE VÁSTAGO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
23	<p>TERMÓMETRO DE VÁSTAGO PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN</p> <p>CONTIENE ESTUCHE DE PLÁSTICO GRUESO QUE MIDE 12.5 CMS DE LARGO, PRESENTA UN ORIFICIO CENTRAL DE 1.5 CMS DE DIÁMETRO CON SISTEMA EXCLUSIVO DE "SAFE-T-GUARD", CON ADITIVOS QUE INHIBEN EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS Y HONGOS, ESTE ESTUCHE FACILITA EL MANEJO DEL TERMÓMETRO, LO PROTEGE CONTRA CHOQUES Y SE PUEDE CALIBRAR.</p> <p>CARÁTULA: DE 1" CON UN VÁSTAGO DELGADO" (0.142") ES DE POLICARBONATO QUE LO HACE IRROMPIBLE, CON NÚMEROS REMARCADOS QUE LE DAN ALTA VISIBILIDAD, LAS ESCALAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS ESTÁN ACENTUADAS, FÁCIL DE LEER LA TEMPERATURA, LA ESCALA ES EXTENDIDA A 360° ANGULARES, ADEMÁS PRESENTA UN RELIEVE QUE LE PERMITE AL PUNTERO MAYOR MOVIMIENTO POR GRADO DE CAMBIO DE TEMPERATURA</p> <p>TODAS LAS PARTES EXTERNAS DEL TERMÓMETRO SON DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>DIAL GRÁFICO DE RANGO DE MEDICIÓN: MÍNIMA - 40°C MÁXIMA +50°C</p> <p>NORMA ISO 9001-2015 NORMA ISO 13485-2003</p> <p>REQUIERE REGISTRO SANITARIO GARANTÍA DE 24 MESES</p>	886



ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUNOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

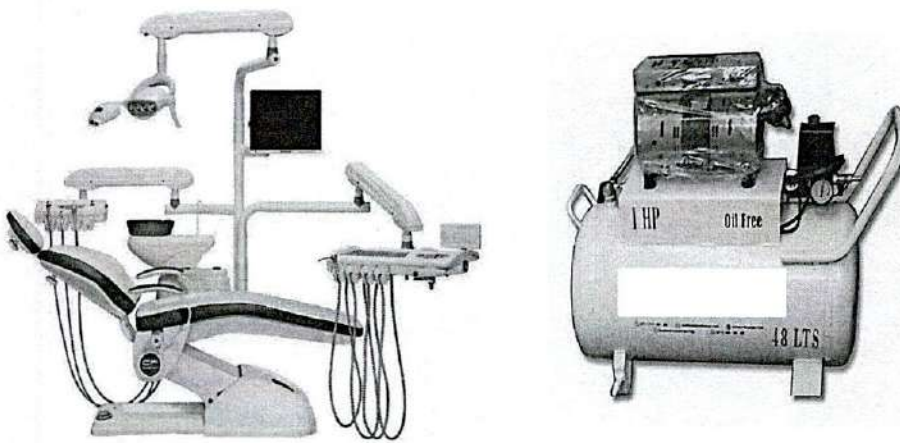
FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:
NOMBRE GENÉRICO: UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO	

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
24	<p>BASE DE ACERO Y PINTURA ANTICORROSIVA CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO CON SISTEMA SILENCIOSO ACCIONADO CON AIRE. CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE.</p> <p>LA UNIDAD DENTAL CON MÓDULO INTEGRADO, DEBE CONTAR CON UN SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AIRE Y AGUA DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO QUE LE PERMITA SU DESPLAZAMIENTO A UN RADIO DE ACCIÓN DE DOS METROS COMO MÍNIMO EN TORNO AL SILLÓN CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS, CON MANGUERAS DE SILICÓN O POLIURETANO ASAS DE DOS VÍAS DE LARGO. UNA LARGO DE 180 A 200 CM CON POSIBILIDAD DE DESMONTARSE EN FORMA AMBIDIESTRA. DOS BANQUILLOS, UNO PARA ESTOMATOLOGICO Y UNO PARA ASISTENTE CON DESCANSA PIES AMBOS CON SISTEMA NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA CON RODAJAS TAPIZADO DE PLÁSTICO TELA RESISTENTE Y LAVABLE.</p> <p>COMPRESOR DE AIRE DE 1 HP COMO MINIMO CON CAPACIDAD DE 35 A 70 LITROS CON SISTEMA DE PURGA DE CONDENSADOS AUTOMÁTICO CON TECNOLOGÍA LIBRE DE ACEITE CON ENTREGA DE AIRE LIMPIO TANQUE CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MINIMO DE 45 LITROS INCLUYE CUBETA REDUCTORA DE RUIDO, ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 3KVA, 127V, 1 FASE CON SUPRESOR DE PICOS (ACONDICIONADOR DE VOLTAJE). MANTENIMIENTO Y GARANTIA POR EL PROVEEDOR DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.</p> <p>LA ORDEN DE ENVÍO POR PARTE DEL PROVEEDOR DEBERA ESPECIFICAR LO SIGUIENTE: MARCA, MODELO Y No. DE SERIE DE LA UNIDAD Y ACCESORIOS MANUALES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL. CERTIFICADO ISO 9000 Y DE LA COMUNIDAD EUROPEA (CE).</p>	4

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 2	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 53101	MARCA:	
CANTIDAD: 4	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GENÉRICO: UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO		
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	<p>REQUIERE CERTIFICADO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EMITIDO POR LA COFEPRIS. NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA GARANTIA 24 MESES</p> 	
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ÁNGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	