

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-018-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, 2023".

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las **11:00** horas del día **17 de julio del año dos mil veintitrés**, de conformidad con lo dispuesto en el **punto 20** de las Bases de Licitación y con fundamento en lo previsto por el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentran reunidos en la Subdirección de Recursos Materiales de Servicios de Salud de Veracruz, sito en Soconusco número 31, Colonia Aguacatal, C.P. 91130, Xalapa, Ver., los C.C. **Lic. Facundo Valdivia Cadena**, Subdirector de Recursos Materiales; **C.P.A. Verónica Ramón Cortina**, Jefa del Departamento de Adquisiciones; **Lic. Roberto Alfredo Herrera Peña** y **Lic. Silvia Janette González Mota**, Representantes de la Dirección Jurídica; **Q.C. Said Alberto Acosta Alvarado**, Representante de la Dirección de Salud Pública; y **L.A.E. Eréndira Torres Sanromán**, Cotizadora adscrita al Departamento de Adquisiciones, integrantes de la Comisión de Licitación, todos ellos servidores públicos de Servicios de Salud de Veracruz; así mismo, se cuenta con la presencia de los C.C. **Mtro. Karlo Pommier Granillo** y **Lic. Esmeralda Solano Landa**, representantes del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, designados mediante oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/2073/2023, a efecto de llevar a cabo el Acto de Junta de Aclaraciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-018-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, 2023"**.

El Acto de Junta de Aclaraciones se celebra bajo el siguiente Orden del día: -----

1. Presentación de los Servidores Públicos.-----
2. Presentación de las Empresas Licitantes.-----
3. Aclaraciones y/o modificaciones a las Bases de la Licitación. -----
4. Respuestas a las preguntas de las Empresas participantes. -----
5. Cierre del Acta y firma de la misma por todos los participantes en el Evento. -----



HECHOS

1. En desahogo del **punto NÚMERO UNO** del Orden del día, se procede a la **presentación de los servidores públicos.** -----

POR SERVICIOS DE SALUD DE SALUD DE VERACRUZ	
Lic. Facundo Valdivia Cadena	Subdirector de Recursos Materiales
C.P.A. Verónica Ramón Cortina	Jefa del Departamento de Adquisiciones
Lic. Roberto Alfredo Herrera Peña	Representantes de la Dirección Jurídica
Lic. Silvia Janette González Mota	
Q.C. Said Alberto Acosta Alvarado	Representante de la Dirección de Salud Pública
L.A.E. Eréndira Torres Sanromán	Cotizadora adscrita al Departamento de Adquisiciones

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	
Mtro. Karlo Pommier Granillo	Representantes del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz
Lic. Esmeralda Solano Landa	

2. En desahogo del **punto NÚMERO DOS** del Orden del día, se informa que no se contó con **empresas participantes.** -----



3. **En desahogo del punto NÚMERO TRES del Orden del día, se procede a hacer del conocimiento de los participantes las modificaciones a la convocatoria y a las bases, realizadas por la convocante, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Punto 19 Capítulo VI de las bases, que a la letra dice "...Cualquier duda o aclaración respecto a la convocatoria y bases de licitación, será resuelta en la Junta de Aclaraciones como lo estipula el artículo 40 de la Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra dice:**

- *La Junta de Aclaraciones tendrá por objeto esclarecer aquellos aspectos de la convocatoria o de las mismas bases que pudieran generar confusión.*
- *Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada de la Junta de Aclaraciones, será considerada como parte de aquellas. ..."*

MODIFICACIÓN No. 1



Página 4

Proemio

Se agrega el siguiente párrafo:

Se cuenta con la **habilitación de los días 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 de julio y 1, 2, 3 y 4 de agosto de 2023**, autorizada en la **Quinta Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de Servicios de Salud de Veracruz, mediante acuerdo N° 11/Ext.05/2023 de fecha 07 de julio de 2023.**

4. **En desahogo del punto NÚMERO CUATRO del Orden del día, se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas en tiempo y forma por parte de los Licitantes, de acuerdo al oficio número DSP/SPyCE/461/2023 de fecha 13 de julio de 2023, signado por la Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores, Directora de Salud Pública.**

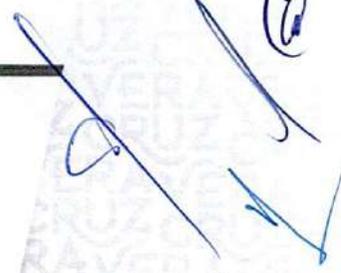

DIKYSA, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	SIN PREGUNTAS	

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>PARTIDA 13 DICE: CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. 1. CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. CON DIMENSIONES: 24 X 50 MM. CAJA CON 150 PIEZAS.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA COTIZAR CAJA CON 100 PIEZAS HACIENDO LA CONVERSION DEL NUMERO DE CAJAS SOLICITADAS.</p> <p>SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA CANTIDAD SOLICITADA.</p>
2	<p>PARTIDAS 22 DICE: CUCHILLAS DESECHABLES DE ALTO PERFIL, PAQUETE CON 100 PIEZAS.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA COTIZAR PAQUETE CON 50 PIEZAS HACIENDO LA CONVERSION DEL NUMERO DE CAJAS SOLICITADAS.</p> <p>SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA CANTIDAD SOLICITADA.</p>





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

3	<p>PARTIDAS 23 DICE: CUCHILLAS DESECHABLES DE BAJO PERFIL PAQUETE CON 100 PIEZAS.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA COTIZAR PAQUETE CON 50 PIEZAS HACIENDO LA CONVERSION DEL NÚMERO DE CAJAS SOLICITADAS.</p> <p>SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA CANTIDAD SOLICITADA.</p>
4	<p>PUNTO 5.- SOLICITAN MUESTRAS PARA LOS RENGLONES 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 37, Y 38.</p> <p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA EN EL CASO DE LAS PÁRTIDAS 22 Y 23 ENTREGAR 1 MUESTRA PARA AMBOS RENGLONES, YA QUE SON FAMILIA Y SÓLO VARÍA EL PERFIL.</p> <p>SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR. DEBE PRESENTAR UNA MUESTRA POR RENGLÓN.</p>
5	<p>PARTIDA 30 DICE: PRUEBAS RÁPIDAS. PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS DE TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO O PLASMA HUMANO. CON SENSIBILIDAD NO MENOR AL 95% Y UNA ESPECIFICIDAD NO MENOR AL 98% DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS O EN SU CASO ALGÚN OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL COMO LA FDA, EMA, O LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. REQUIERE PRUEBA CONFIRMATORIA. CAJA CON 20 PRUEBAS.</p> <p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CAJA CON 25 PRUEBAS HACIENDO LA CONVERSION DEL NÚMERO DE CAJAS SOLICITADAS.</p> <p>SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.</p>





6	<p>PARTIDA 30 DICE: PRUEBAS RÁPIDAS. PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS DE TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO O PLASMA HUMANO. CON SENSIBILIDAD NO MENOR AL 95% Y UNA ESPECIFICIDAD NO MENOR AL 98% DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS O EN SU CASO ALGÚN OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL COMO LA FDA, EMA, O LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. REQUIERE PRUEBA CONFIRMATORIA. CAJA CON 20 PRUEBAS</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIEREN LANCETA DE SEGURIDAD DE TRES NIVELES DE PUNCIÓN Y BUFER DE CORRIMIENTO POR PRUEBA?</p>	<p>ES CORRECTO, SE REQUIERE LANCETA CON TRES NIVELES DE PUNCIÓN Y BUFFER DE CORRIMIENTO POR PUEBA, APEGADO A LA FICHA TÉCNICA.</p>
7	<p>PARTIDA 34 DICE: TIRA REACTIVA. PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR CON LIMITE DE MEDICIÓN EN GLUCOMETRO HASTA 500 o 600 mg/dl. CON MEMBRANA HIDROFILICA IMPREGNADA CON ACTRIVANTE QUIMICO: GLUCOSA OXIDASA CON REDUCTOR E INDICADOR O GLUCOSA DESHIDROGENASA. PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. TATC ENVASE CON 50 PRUEBAS.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME PARA QUE MODELO DE EQUIPO SOLICITAN LAS TIRAS. O BIEN SI REQUIEREN EQUIPO EN COMODATO?</p>	<p>EL INSUMO DEBE SER COMPATIBLE CON GLUCÓMETRO MARCA ACCUCHECK MODELO ACTIVE.</p>
8	<p>PARTIDA 35 DICE: ANTÍGENO PROSTÁTICO PRUEBA RÁPIDA. CAJA CON 25 PRUEBAS.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS INSUMOS SOLICITADOS DEBEN VENIR POR PRUEBA Y AUTORIZADO EN REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR COFEPRIS?</p>	<p>SI ES CORRECTO, EL KIT DE PRUEBAS DEBEN VENIR EMPAQUETADAS DE MANERA INDIVIDUAL EN CAJA CON 25 PIEZAS, Y LA PROPUESTA DEBE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR COFEPRIS.</p>
9	<p>PARTIDA 35 DICE: ANTÍGENO PROSTATICO PRUEBA RÁPIDA. CAJA CON 25 PRUEBAS</p> <p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITAN OFERTAR PRUEBA RÁPIDA DE DETERMINACIÓN DE PSA CON DOS LINEAS DE PRUEBA. SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA. EL REQUERIMIENTO ESTABLECE QUE LA PRUEBA DEBE CONTAR CON 3 LÍNEAS: UNA LÍNEA DE CONTROL, UNA DE PRUEBA Y UNA DE REFERENCIA.</p>





2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

10	<p>PARTIDA 36 DICE: BALSAMO DE CANADA PARA MICROSCOPIA FRASCO CON 25 ML.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR PRESENTACION CON 30 ML.</p> <p>SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
11	<p>PARTIDA 37 DICE: PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRFÍA, CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1(VIH-1) Y TIPO 2 (VIH-2) EN FLUIDO ORAL, SANGRE CAPILAR, SANGRE TOTAL Y PLASMA. PARA USO COMO PRUEBA DE TAMIZAJE. KIT.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS EN LA FICHA TÉCNICA DEBEN VENIR EN EL REGISTRO SANITARIO POR PRUEBA Y AUTORIZADOS POR LA COFEPRIS?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBEN DE CONTAR CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS SANITARIOS.</p>

SISTEMAS BIOMÉDICOS DE DIAGNÓSTICO, S.A. DE C.V.

A) DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PONGA A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES LAS BASES EN FORMATO WORD ESTO CON EL FIN DE PRESENTAR DE MANERA CORRECTA LOS ANEXOS SOLICITADOS.</p> <p>EN CASO DE SER ACEPTADA NUESTRA PETICIÓN, SOLICITAMOS QUE SEAN OTORGADAS SOLO PRESENTANDO EL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES.</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO DICHA PETICIÓN SEA EFECTUADA POR ESCITO AL CORREO ELECTRÓNICO adquisiciones@ssaver.gob.mx, ANEXANDO COMPROBANTE DE PAGO DE BASES Y ESPECIFICANDO EL CORREO ELECTRÓNICO AL CUAL DEBERÁ SER ENVIADO.</p>



B) DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>PUNTO 4, PÁG. 6 DICE: EL O LOS PROVEEDORES(ES) QUE RESULTE(N) ADJUDICADO(S) EN LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ(N) GARANTIZAR QUE LOS INSUMOS CONTARÁN CON UN PERIODO MÍNIMO DE CADUCIDAD DE 18 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN "B" PERTENECIENTE A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. DICHA GARANTÍA DEBERÁ CONTEMPLAR DEFECTOS DE FABRICACIÓN, COMPOSICIÓN O VICIOS OCULTOS, Y EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A CAMBIAR LOS INSUMOS QUE ASÍ LO AMERITEN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN QUE REALICE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, POR ESCRITO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA GARANTÍA DE CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES, PRESENTANDO CARTA CANJE, QUE COMPROMETA A LA SUSTITUCIÓN DE CUMPLIRSE LA CADUCIDAD, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>
2	<p>PÁG. 40, RENGLÓN 30. PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS DE TREPONEMA PALLIDUM.</p> <p>LA PRUEBA CONFIRMATORIA ACTUALMENTE NO SE FABRICA PARA PRUEBAS RÁPIDAS INMUNOCROMATOGRÁFICAS, EN TAL VIRTUD PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SE CONSIDERE COMO OPCIONAL O SE ELIMINE DE LA DESCRIPCIÓN, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

<p>3</p>	<p>PÁG. 40, RENGLÓN 30.</p> <p>PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS DE TREPONEMA PALLIDUM.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UNA PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS DE TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO O PLASMA HUMANO, CON SENSIBILIDAD NO MENOR AL 98% Y UNA ESPECIFICIDAD NO MENOR AL 94% DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICOS, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>
<p>4</p>	<p>PÁG. 40, RENGLÓN 30.</p> <p>PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS DE TREPONEMA PALLIDUM.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE UNA FICHA TÉCNICA DEL INSUMO.</p>	<p>APEGARSE A LO DESCRITO EN LA CLAVE DE CUADRO BÁSICO CONTENIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>
<p>5</p>	<p>PÁG. 40, RENGLÓN 30.</p> <p>PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS DE TREPONEMA PALLIDUM.</p> <p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRESENTACIÓN DE CAJA CON 40 PRUEBAS SIN MODIFICAR O ALTERAR LAS CANTIDADES FINALES SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR, SIEMPRE QUE CADA PRUEBA Y SUS ACCESORIOS SE OFERTEN EN EMPAQUE INDIVIDUAL, CON BASE A LA FICHA TÉCNICA.</p>



<p>6</p>	<p>PÁG. 50, RENGLÓN 35.</p> <p>DICE: ANTÍGENO PROSTÁTICO PRUEBA RÁPIDA.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA CON ORO COLOIDAL PARA LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO CON UN NIVEL DE DETECCIÓN ENTRE 3 -10 NG/ML, DESCRIPCIÓN QUE CUENTA CON ESPECIFICACIONES SUPERIORES A LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR, DEBE TENER UNA SENSIBILIDAD DE 2NG/ML.</p>
<p>7</p>	<p>PÁG. 50, RENGLÓN 35.</p> <p>ANTÍGENO PROSTÁTICO PRUEBA RÁPIDA.</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAJA CON 25 CASSETTES DE PRUEBA CON PIPETA PASTEUR EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE, CON 1 BUFFER DE 3 ML; Y ADICIONALMENTE OFERTAR 1 LANCETA Y 1 TOALLA ALCOHOLADA POR CADA PRUEBA REQUISITADA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR, YA QUE SE SOLICITÓ CAJA CON 25 KITS CON EMPAQUE INDIVIDUAL POR PRUEBA QUE CONTENGA 1 BUFFER 1 LANCETA Y 1 TOALLITA ALCOHOLADA.</p>
<p>8</p>	<p>PÁG. 41, RENGLÓN 37.</p> <p>PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFÍA, CONTRA EL VIH.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UNA PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFÍA, CONTRA EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 (VIH-1) Y TIPO 2 (VIH-2) EN MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR, SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA. PARA USO COMO PRUEBA DE TAMIZAJE. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>



Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page.

CENTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
	SIN PREGUNTAS	

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO




NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>CAPITULO 1 DESCRIPCION GENERAL DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACION, CONDICIONES Y FECHA DE ENTREGA</p> <p>PUNTO 5.- MUESTRAS DE LOS SIGUIENTES RENGLONES 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 37 Y 38</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME CONFIRME SI DEBEMOS PRESENTAR LA MUESTRA CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA O ME PERMITA PRESENTAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, CONFORME A LA UNIDAD DE MEDIDA</p>
2	<p>DOCUMENTO 6</p> <p>ANEXO No. 2 CATALOGOS O FOLLETOS</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA INTEGRAR DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA FICHAS TECNICAS, YA QUE LOS FABRICANTES YA NO MANEJAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>

(Handwritten signatures and initials)



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

3	<p>DOCUMENTO 10 CARTA DE RESPALDO DEL (LOS) FABRICANTES(S) Y/O FILIAL DE MEXICO, Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA INTEGRAR DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA CARTA DE RESPALDO DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA.</p>	<p>APEGARSE A BASES.</p>
4	<p>DOCUMENTO 12 COPIA DE REGISTROS SANITARIOS</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA LOS PRODUCTOS QUE NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, ME PERMITA INTEGRAR DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA LOS INSUMOS QUE APLIQUE.</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>
5	<p>DOCUMENTO 21 ANEXO 9 ACUSE DEBIDAMENTE SELLADO EN ORIGINAL Y COPIA</p> <p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME ACLARE, QUE SI DICHO ANEXO SELLADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SE DEBERÁ INTEGRAR DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA O SOLO SE DEBERA PRESENTARSE AL MOMENTO DE LA APERTURA.</p>	<p>DEBERÁ INTEGRARSE DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.</p>

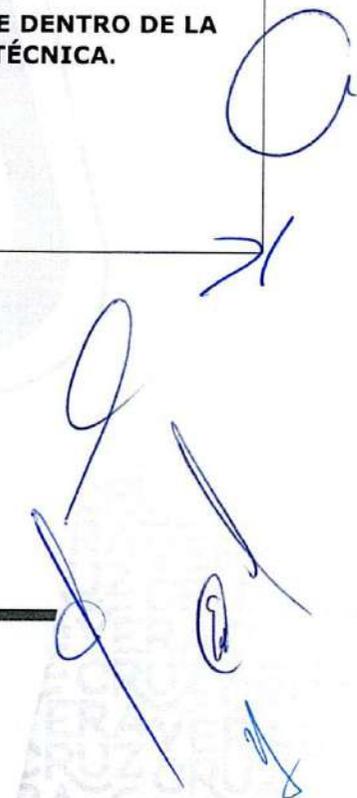

MARISSA CORNELIA ACOSTA CEBALLOS

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>CAPITULO I DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, CONDICIONES Y FECHA DE ENTREGA.</p> <p>PUNTO 6. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ HACER LA ENTREGA DE LOS INSUMOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS HÁBILES.</p> <p>PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PUEDA AJUSTAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 30 DÍAS HÁBILES. SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN BASES.</p>
2	<p>CAPITULO VII INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE OFERTAS. DOCUMENTO 9: PERIODO MINIMO DE GARANTIA DE 18 MESES.</p> <p>PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PUEDA RECIBIR MATERIAL CON 12 MESES DE GARANTIA, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS. SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL PROVEEDOR PRESENTE CARTA CANJE COMO SE ESPECIFICA EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>
3	<p>DOCUMENTO 10: CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE, FILIAL EN MEXICO, IMPORTADOR PRIMARIO.</p> <p>PREGUNTA: SE ENTIENDE QUE SERÁ CARTA ORIGINAL, CON LA FIRMA AUTÓGRAFA EN ORIGINAL POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA QUE DÉ EL APOYO AL LICITANTE, Ó ACEPTARÁN CARTAS IMPRESAS ELECTRONICAMENTE?</p>	<p>DEBERÁ PRESENTARSE CARTA DE RESPALDO ORIGINAL, CON FIRMA AUTÓGRAFA.</p>



B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>ANEXO TECNICO REGLÓN 13: CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. 1. CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. CON DIMENSIONES: 24 x 50 MM. CAJA CON 150 PZAS.</p> <p>PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE CAJA CON 100 PIEZAS YA QUE ACTUALMENTE EN EL MERCADO NO EXISTE PRESENTACION DE 150 PIEZAS. SE ACEPTA?</p>	<p>SI SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL NÚMERO TOTAL DE PIEZAS EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS.</p>
2	<p>PREGUNTA: SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE RESPONDER: <u>SE ACEPTA A LA PREGUNTA ANTERIOR</u>, INDIQUE LA CANTIDAD DE CAJAS SOLICITADAS TOTALES.</p>	<p>255 CAJAS CON 100 PIEZAS.</p>
3	<p>REGLÓN 30: PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS DE TREPONEMA PALLIDUM EN SUERO O PLASMA HUMANO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAN CAJA CON 20 PRUEBAS. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAJA CON 40 PRUEBAS. SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>
4	<p>EN CASO DE RESPONDER: SE ACEPTA EN LA PREGUNTA ANTERIOR, LA CANTIDAD A OFERTAR SERAN 220 CAJAS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
5	<p>REGLON 37: PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFIA, CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO I (VIH-1) Y TIPO 2 (VIH-2) EN FLUIDO ORAL,SANGRE CAPILAR, SANGRE TOTAL, PLASMA.</p>	






2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

	<p>PREGUNTA: EN LA FICHA TÉCNICA SOLICITAN KIT DE 25 PRUEBAS. SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR KIT INDIVIDUAL, EL CUAL CUENTA CON UN REGISTRO SANITARIO VIGENTE ANTE COFEPRIS PARA LA VENTA DE KIT QUE CONTIENE:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 PRUEBA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE PAPEL ALUMINIO CON CASETE Y PIPETA PASTEUR. 1 BUFFER DILUYENTE 1 LANCETA ESTÉRIL RETRÁCTIL MULTINIVEL 1 TOALLITA ALCOHOLADA 1 CURITA 1 INSTRUCTIVO. <p>SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>
6	<p>PREGUNTA: EN CASO DE RESPONDER SE ACEPTA, EL TOTAL DE PRUEBAS SOLICITADAS ES DE 57,625, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>

LABORATORIOS SAAV, S.A. DE C.V.

A). - DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL

NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>DOCUMENTO 28.- SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ÚLTIMO PAGO PROVISIONAL DE LA DECLARACIÓN MENSUAL, ES EL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>







2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

2	<p>DOCUMENTO 12.- REGISTRO SANITARIO VIGENTE</p> <p>DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO, SE PERMITA SUSTENTAR CON DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DOF: 22/12/2014 ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>
----------	---	--

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO



NO.	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	<p>REGLON 30 PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS DE TREPONEMA PALLIDUM.</p> <p>DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A ESTA HONORABLE CONVOCANTE PERMITA LA ENTREGA DE BUFFER COLECTIVO CORRESPONDIENTE A CADA CAJA QUE CONTIENE LA PRUEBA SOLICITADA, A EFECTO DE ASEGURAR LA FUNCIONALIDAD EN LA REALIZACIÓN DE CADA PRUEBA ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR, DEBIENDO CUBRIR EL TOTAL DE LAS PRUEBAS SIN FALTANTES.</p>
2	<p>REGLON 30 PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS DE TREPONEMA PALLIDUM.</p> <p>EN LA ACTUALIDAD LA PRUEBA CONFIRMATORIA NO ESTÁ SIENDO FABRICADA EN ESTE TIPO DE PRUEBA RAPIDA. PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR COMO OPCIONAL LA PRUEBA CONFIRMATORIA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>

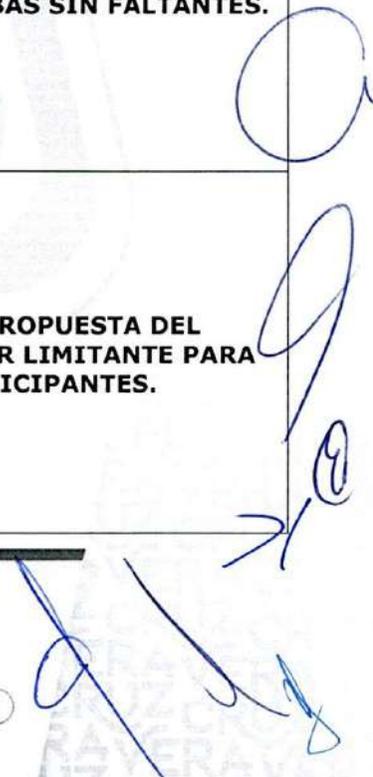



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

3	<p>RENGLÓN 34 TIRA REACTIVA. PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR.</p> <p>EN VIRTUD DE NO CONOCER LA MARCA DEL GLUCOMETRO EN EL QUE SERÁN UTILIZADAS LAS TIRAS REACTIAS SOLICITADAS, Y POR ENDE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR COMPATIBILIDAD EN USO DEL REQUERIMIENTO, SE SOLICITA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES LICITATORIAS, Y DE FABRICANTE PROPIO, INCLUYENDO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA 30 GLUCÓMETROS NUEVOS DE MANERA GRATUITA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR YA QUE LA COBERTURA DE LOS EQUIPOS QUE PROPONE NO ES SUFICIENTE PARA LAS UNIDADES EN LAS QUE SE OCUPA DICHO DISPOSITIVO. APEGARSE A BASES.</p>
4	<p>RENGLÓN 34 TIRA REACTIVA. PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR. EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA ATENTAMENTE A ESTA HONORABLE CONVOCANTE QUE NOS PROPORCIONE LA MARCA Y MODELO DEL GLUCÓMETRO COMPATIBLE CON LAS TIRAS REACTIVAS SOLICITADAS.</p> <p>FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>EL INSUMO DEBE SER COMPATIBLE CON GLOCOMETRO MARCA ACCU CHECK MODELO ACTIVE.</p>
5	<p>RENGLON 35 ANTÍGENO PROSTÁTICO LA PRESENTACIÓN SOLICITADA ES CAJA CON 25 PRUEBAS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA PRESENTACIÓN DE 50 PIEZAS, ENTREGANDO LA TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO DE LA DEPENDENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR SIN SER LIMITANTE PARA OTROS PARTICIPANTES.</p>
6	<p>RENGLON 35 ANTÍGENO PROSTÁTICO ATENTAMENTE SOLICITAMOS A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS PERMITA LA ENTREGA DE BUFFER COLECTIVO PARA LAS PRUEBAS, LO QUE GARANTIZA LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE LAS PRUBAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, CADA KIT DEBE CONTENER UN BUFFER INDIVIDUAL POR PRUEBA.</p>

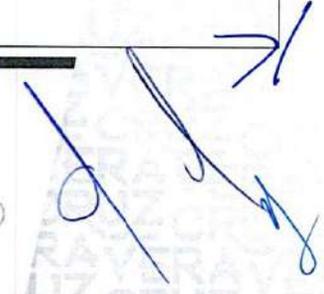



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

7	<p>REGLON 35 ANTÍGENO PROSTÁTICO EL KIT DEBE INCLUIR PIPETA PASTEUR, BUFFER, LANCETAS RETRACTILES DE TRES NIVELES DE PROFUNDIDAD DESECHABLE Y TOALLITAS ALCOHOLADAS. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ES VIABLE ENTREGAR TODOS LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS ACORDE A LA PRESENTACIÓN OFERADA DE MANERA INDEPENDIENTE A LA CAJA CON LAS PRUEBAS, CUMPLIENDO CON LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR, YA QUE SE SOLICITÓ CAJA CON 25 KITS CON EMPAQUE INDIVIDUAL POR PRUEBA QUE CONTENGA 1 BUFFER 1 LACENTA Y 1 TOALLITA ALCOHOLADA .</p>
8	<p>REGLON 35 ANTÍGENO PROSTÁTICO SE CONSULTA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, QUÉ TIPO DE ANTICUERPO REQUIEREN QUE SEA MONOCLONALES O ANTICUERPOS POLICLONALES, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>SE REQUIEREN MONOCLONALES.</p>
9	<p>REGLON 37 PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFÍA. LA CONVOCANTE SOLICITA UNA PRESENTACIÓN DE 20 PRUEBAS POR CAJA. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESTA HONORABLE CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 50 PRUEBAS POR CAJA ENTREGANDO LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA POR LA DEPENDENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA, DEBIENDO CUBRIR EL TOTAL DE PRUEBAS SOLICITADAS.</p>
10	<p>REGLON 37 PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFÍA. DE LA MANERA MAS ATENTA SE SOLICITA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL MÉTODO EN SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA PARA USO EN PRUEBA DE TAMIZAJE MEDIANTE UN MÉTODO DE EIA SEGUIDA POR UNA CONFIRMACIÓN WESTERN BLOT. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, POR QUE LA CONFIRMACIÓN DE WESTERN BLOT NO ES UN MEDIO VALIDADO POR CENSIDA (CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL VIH Y SIDA).</p>



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

<p>11</p>	<p>RENGLON 37 PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFÍA.</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS PERMITA LA ENTREGA DE BUFFER COLECTIVO CORRESPONDIENTE A CADA CAJA QUE CONTIENE LAS PRUEBAS SOLICITADAS, LO ANTERIOR SIN DETRIMENTO DE LA FUNCIONALIDAD EN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, CADA KIT DEBE CONTENER UN BUFFER INDIVIDUAL POR PRUEBA.</p>
<p>12</p>	<p>RENGLON 37 PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFÍA.</p> <p>EL KIT DEBE INCLUIR PIPETA PASTEUR, BUFFER, LANCETAS RETRÁCTILES DE TRES NIVELES DE PROFUNDIDAD DESECHABLE Y TOALLITAS ALCOHOLADAS.</p> <p>ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO ES VIABLE ENTREGAR TODOS LOS CONSUMIBLES SOLICITADOS DE MANERA INDEPENDIENTE A LA CAJA CON LAS PRUEBAS, CUMPLIENDO CON LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR KIT EN EMPAQUE INDIVIDUAL QUE CONTENGA LOS INSUMOS REQUERIDOS EN FICHA TÉCNICA, DEBIDO A QUE GARANTIZA LA CORRECTA DISTRIBUCION Y APLICACIÓN DE CADA PRUEBA.</p>
<p>13</p>	<p>RENGLÓN 38 TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCEMIA.</p> <p>PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD EN USO DEL REQUERIMIENTO, SE SOLICITA A ESTA HONORABLE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCEMIA, ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES LICITATORIAS, Y DE FABRICANTE PROPIO, INCLUYENDO DENTRO DE NUESTRA PROPUESTA 170 GLUCÓMETROS NUEVOS DE MANERA GRATUITA.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR YA QUE LA COBERTURA DE LOS EQUIPOS QUE PROPONE NO ES SUFICIENTE PARA LAS UNIDADES EN LAS QUE SE OCUPA DICHO DISPOSITIVO.</p>



2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Se concluye la etapa de preguntas y respuestas presentadas en tiempo y forma.-----

SE HACE CONSTAR QUE LAS RESPUESTAS ANTES MENCIONADAS NO SON LIMITATIVAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. -----

De conformidad con el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, esta acta forma parte integrante de la convocatoria y los acuerdos tomados en este acto son obligatorios para todos.-----

Publíquese la presente Acta en el portal de la convocante en la dirección electrónica <https://www.ssavever.gob.mx/adquisiciones/licitaciones-2023/> a efecto de ponerlo a disposición de los licitantes, pudiendo obtener copia de la misma en el Departamento de Adquisiciones, siendo responsabilidad de los Licitantes acudir a enterarse de su contenido.-----

Se reitera a los participantes que deberán presentar en su propuesta técnica el acuse debidamente sellado en original y copia del escrito bajo protesta de decir verdad en el que el licitante manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se genera un conflicto de interés, el cual el licitante debió haber presentado al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. En caso de que sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. Anexo No. 9 solicitado en el Documento 21 de las Bases de Licitación. -----

Finalmente se reitera que **el Acto de Presentación y Apertura se llevará a cabo el día 26 de julio de 2023 a las 11:00 horas** en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales de Servicios de Salud de Veracruz, ubicada en Soconusco No. 31, Col. Aguacatal, C.P. 91130, de Xalapa, Ver. -----

5. Punto NÚMERO CINCO del Orden del día, cierre del Acta. -----

En desahogo del **punto NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA** Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS **11:30 horas** del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce a entera satisfacción los que en ella intervinieron. La falta de firma de alguno de los participantes en este acto no invalida el contenido de la misma. -----





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

POR SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

LIC. FACUNDO VALDIVIA CADENA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

C.P.A. VERÓNICA RAMÓN CORTINA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

LIC. ROBERTO ALFREDO HERRERA PEÑA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA

LIC. SILVIA JANETTE GONZÁLEZ MOTA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA

Q.C. SAID ALBERTO ACOSTA ALVARADO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
SALUD PÚBLICA

L.A.E. ERÉNDIRA TORRES SANROMÁN
COTIZADORA

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA
DE SALUD Y EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ**

MTRO. KARLO POMMIER GRANILLO
REPRESENTANTE

LIC. ESMERALDA SOLANO LANDA
REPRESENTANTE

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-103T00000-018-2023, RELATIVA A LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, 2023".



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023