



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICRÓFONO CONDENSADOR

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	MICRÓFONO CONDENSADOR 16 BIT MONTABLE DE DIAFRAGMA DUAL PATRONES POLARES: UNIDIRECCIONAL. RESPUESTA DE FRECUENCIA: 20 HZ - 16 KHZ. CONECTOR DE SALIDA XLR GARANTÍA DE 12 MESES DIMENSIONES: MANGO: 54 MM, LONGUITUD: 180 MM PESO: 420 GRS COLOR INDISTINTO	1



ELABORÓ:	BIOL. ARTURO BAEZ HERNANDEZ - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

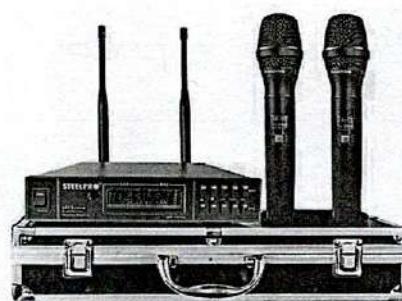
AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 4	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: KIT DE MICROFONO PROFESIONAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	KIT DE MICROFONO PROFESIONAL ALCANCE DE 100 METROS 45 CANALES DE FRECUENCIA RECEPTOR DE MICROFONO INALAMBRICO CON SALIDA DE 6.35 MM Y 2 SALIDAS BALANCEADAS XLR DESVIACIÓN DE FRECUENCIAS ±44 kHz RESPUESTA DE FRECUENCIA 65Hz-20kHz ±3dB FRECUENCIA UHF 630-697 MHz QUE CONTENGA 2 MICROFONOS INALAMBRICOS 1 RECEPTOR PROFESIONAL CON PANTALLA DINAMICA 2 ANTENAS 2 ANILLOS PROTECTORES ANTIVUELCO CABLE 6.3 A 6.3 CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN 1 MALETA PARA FACILITAR SU TRANSPORTE GARANTÍA DE 24 MESES	4



ELABORÓ:	DRA. LILIANA MATILDE LOEZA TORRES - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

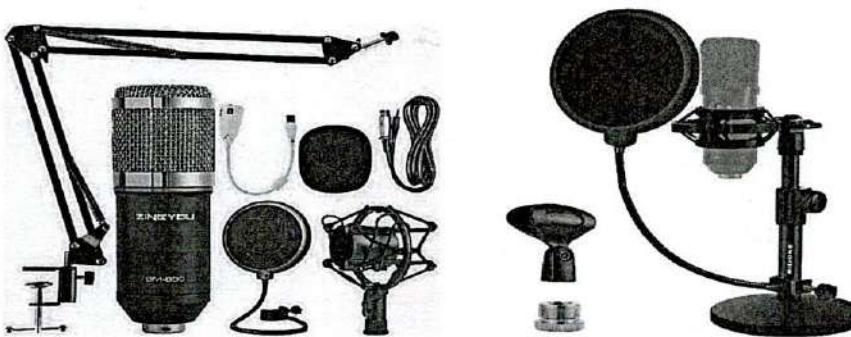



AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICRÓFONO INALÁMBRICO CON SOPORTE AJUSTABLE CON FILTRO POP

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	<p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <p>MICRÓFONO</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * EQUIPO DE GRABACIÓN DE ESTUDIO PROFESIONAL INALÁMBRICO * INCLUYE FILTRO POP, SOPORTE DE SUSPENSIÓN REGULABLE, TAPA ESPUMA ANTIVIENTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y TARJETA DE SONIDO. * CAPTURA SENSIBLE CON CÁPSULA DE DIAFRAGMA DE MATERIAL FINO QUE VIBRA Y ENVÍA UNA SEÑAL A LA SALIDA CUANDO ESTÁ OCUPADO Y ES GOLPEADO POR ONDAS DE SONIDO, PROPORCIONANDO UN REPRESENTACIÓN EXTREMADAMENTE PRECISA Y MUY DETALLADA DE LO QU SUENA * IDEAL TANTO EN VOCALES COMO EN INSTRUMENTOS DE REFERENCIA ANCHA IDEAL PARA CAPTURAR VOCES, CUERDAS DE GUITARRAS ACÚSTICAS, PIANOS YA QUE EL CONDENADOR ES CAPAZ DE TOMAR UNA CAPTURA PRECISA E INSTANTANEA DE TODOS LOS MATICES Y SUTILEZAS INHERENTES A ESTOS INSTRUMENTOS * CUENTA CON ALTA SNR, LO QUE SIGNIFICA MENOS DISTORSIÓN CAUSADA EN EL PROCESO DE GRABACIÓN, SISTEMA UNICO DE TRES CAPAS QUE EVITA RUIDOS NO DESEADOS, PROPORCIONANDO UN RENDIMIENTO CLARO Y SIN RUIDO <p>SOPORTE DE MICRÓFONO</p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * SOPORTE DE MICRÓFONO AJUSTABLE CON FILTRO POP * CLIP DE MICRÓFONO * BASE AJUSTABLE DE ALTURA CON ADAPTADOR DE METAL DE 5/8 A 3/8 PULGADAS * DIMENSIÓN DE LA BASE ES DE 12.6 CMS <p>GARANTÍA DE 12 MESES</p> 	1
ELABORÓ:	ING. MARIANO TOVAR RÍOS.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE CULTURA EN SALUD	
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPIN RAMÍREZ.- SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES.- DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	