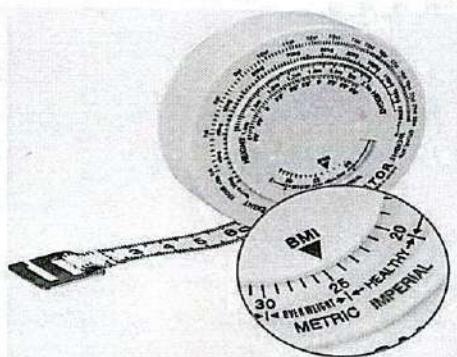


AREA SOLICITANTE: DIRECCION DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: CINTA ANTROPOMÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO.

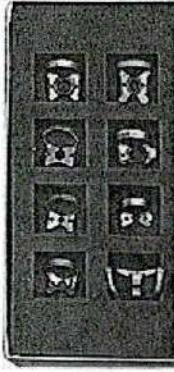
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CINTA ANTROPOMÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO. GRADUACIÓN EN CM Y MM. BOTÓN RETRÁCTIL, FORMA CIRCULAR. CAPACIDAD: 150 CM CON PRECISIÓN DE 1 MM. MEDICIÓN DEL DIÁMETRO DE CINTA: 14 MM DE ANCHO SERIGRAFÍA: IMC EN LA PLATAFORMA GIRATORIA. APROBADA POR FDA PARA USO CLÍNICO SE NECESITA MUESTRA. GARANTÍA 24 MESES	5
		
<p>ELABORÓ: DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES</p>		
<p>REVISÓ: DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES</p>		
<p>AUTORIZÓ: DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA</p>		

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT CON 8 PIEZAS	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: KIT DE GRAPAS PARA DIQUE DE GOMA

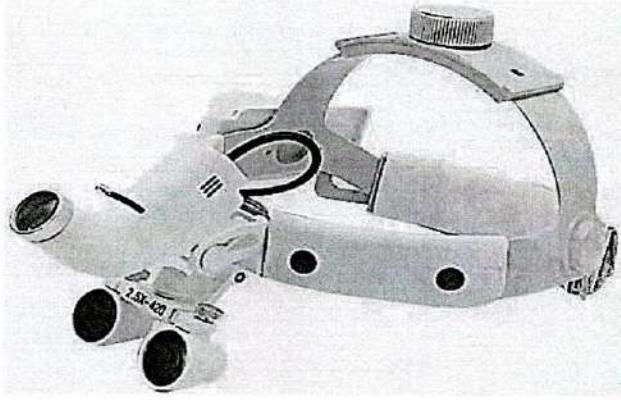
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	QUE CONTENGA: PORTAGRAPAS, PERFORADOR, ARCO (ADULTO), PLANTILLA UNIVERSAL, PLANTILLA FDI, TABLERO ORGANIZADOR Y GRAPAS DE DIQUE DE GOMA DE #0, #1, #2, #7, #8, #8A, #14A Y #212 DE ACERO INOXIDABLE SATIN STEEL PATENTADO. REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTIA 24 MESES	10
		
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 24	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LÁMPARA BONEW DIADEMA DE CUERO

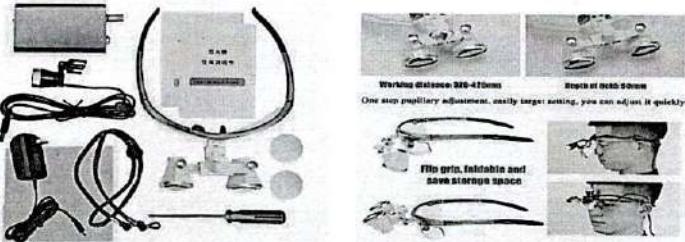
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	<p>LÁMPARA BONEW DIADEMA DE CUERO SUR~GIC, DE 5 W, CON LUZ, 2,5 X 420 MM, DY-105 (BLANCO) CON BINOCULARES. COMBINADO CON UN FARO DE 5 W. BATERÍA RECARGABLE O CON ADAPTADOR DE CORRIENTE CA. NORMA ISO 9001-2000. NORMA ISO 13485-2003. REQUIERE REGISTRO SANITARIO. SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTIA 24 MESES.</p> 	24
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: LUPA BINOCULAR DE AUMENTO

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	<p>LUPA BINOCULAR DE AUMENTO 3,5 X 420 MM CON LUCES LED, BATERIA DE LITIO RECARGABLE, UN ADAPTADOR DE CORRIENTE, DESTORNILLADOR, CLIP DE ALAMBRE Y PAÑO DE LIMPIEZA.</p> <p>AMPLIACION: 3.5X. COLOR BLANCO.</p> <p>DISTANCIA DE TRABAJO: 320-420 MM</p> <p>PROFUNDIDAD DE VISION: 90 MM / 80 MM.</p> <p>CAMPO DE VISION: 100 MM / 60 MM</p> <p>POTENCIA: 3W. TIEMPO DE TRABAJO: 5 HORAS.</p> <p>INTENSIDAD: 15000-30000 LUX</p> <p>VIDA UTIL DE LA BOMBILLA: 10000 HORAS.</p> <p>VOLTAJE DE ENTRADA: AC100-240V / 50-60HZ.</p> <p>MANUAL DE USUARIO.</p> <p>REQUIERE REGISTRO SANITARIO</p> <p>SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES.</p> <p>GARANTIA DE 24 MESES</p> 	5

ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

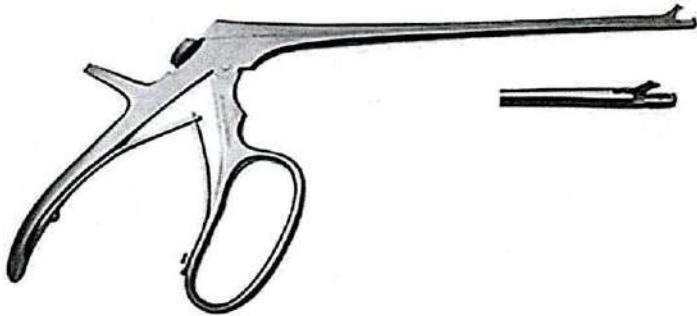
AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 7	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA DE BIOPSIA BABY TISCHLER

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	PINZA DE BIOPSIA BABY TISCHLER FIJA FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE LONGITUD DE 25 CM CON SEGURO REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTÍA DE 24 MESES	7



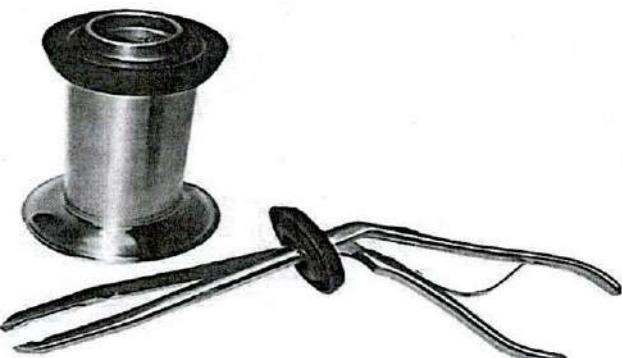
ELABORÓ:	M.S.P. MAGDA ELENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ - DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 5	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.701.1203	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZAS PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL. LONGITUD DE 240 A 260 MM REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTÍA 24 MESES	5
		
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

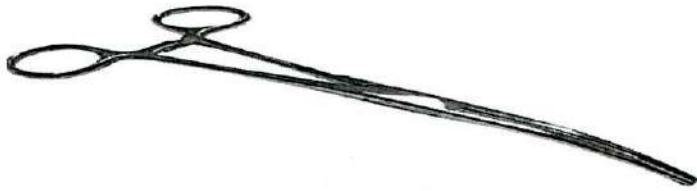
AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 45	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.701.1625	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PINZA DE HEMOSTASIA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	INSTRUMENTAL FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE LONGITUD DE 20 CM NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO GARANTÍA DE 24 MESES.	45
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



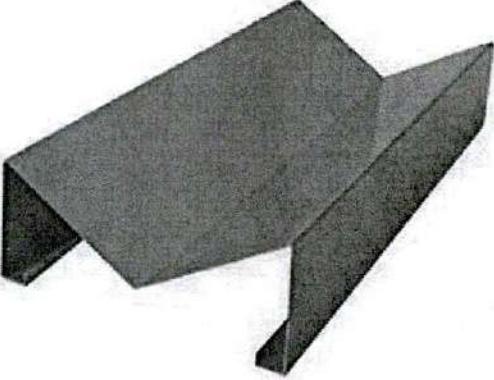
VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 6	MODELO:
CLAVE S.S.:S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: POSICIONADOR O BASE DE EXPLORACIÓN PARA MASCOTA


RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	<p>BASES PARA EXPLORACIÓN DE MASCOTAS O PROPORCIONADOR VETERINARIO PARA MESAS DE CIRUGÍA.</p> <p>FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CHAPA CALIBRE 16.</p> <p>BASE MEDIDA 27 DE ANCHO, 70 CM DE LARGO Y 10.5 CM DE ALTO.</p> <p>NORMA ISO 9001-2000</p> <p>NORMA ISO 13485-2003</p> <p>REQUIERE REGISTRO SANITARIO</p> <p>GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	6
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 10	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: SET CON 6 PIEZAS	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: SET DE SUTURA

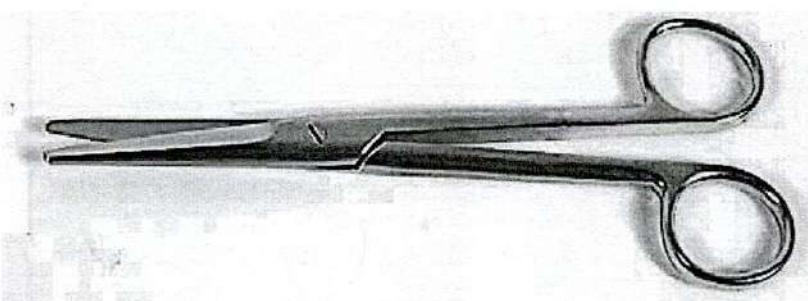
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	INCLUYE INSTRUMENTAL FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE: 1. PORTAGUJA. 2. PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 10 Ó 12 Ó 18 CM. 3. PINZA DE KOCHER DE 1 X 2 DIENTES DE 13 CM. 4. PINZA HEMOSTÁTICA CURVA DE CRILLE DE 16 CM. 5. TIJERA DE MAYO RECTA DE 14.5 CM. 6. CHAROLA. NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTIA 24 MESES	10
		
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 22	MODELO:
CLAVE S.S.: 535.859.4884	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TIJERA MAYO-STILLE, RECTA.

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM. NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 REQUIERE REGISTRO SANITARIO GARANTÍA DE 24 MESES.	22
		
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: 513.887.0059	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: TORUNDERA CON TAPA

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
19	<p>TORUNDERA CON TAPA FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD ESTERILIZABLE CAPACIDAD DE 250 ML. ACABADO PULIDO. NORMA ISO 9001-2000 NORMA ISO 13485-2003 SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES. GARANTÍA DE 24 MESES.</p> 	1
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud



SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



MILENIO DE OBRILLA

AREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 53201	MARCA:
CANTIDAD: 9	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE CON 10 PIEZAS	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: PUNTAS PARA ESCAREADOR CAVITRON

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	<p>PUNTAS PARA ESCAREADOR CAVITRON.</p> <p>CABEZAL DE LIMPIEZA ULTRASONICA, SUPERFICIE CONCAVA CURVADA DEL CABEZAL. PAQUETE CON PUNTAS NÚMERO P1 G1 G2 G3 G4 (2 PIEZAS DE CADA UNA) TOTAL 10 PUNTAS.</p> <p>NORMA ISO 9001-2000</p> <p>NORMA ISO 13485-2003</p> <p>REQUIERE REGISTRO SANITARIO</p> <p>SE REQUIERE CATÁLOGO REFERENCIADO CON IMÁGENES.</p> <p>GARANTIA DE 24 MESES.</p>	9
ELABORÓ:	DRA. PATRICIA DE LOS ANGELES MUÑOZ FLORES - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA 	